

MADSEN Zodiac
Diagnostic & Clinical
Wersja komputerowa
Instrukcja obsługi

Nr dok.7-50-1730-PL/04
Nr części7-50-17300-PL

Informacja o prawach autorskich

Producent upoważnia firmę GN Otometrics A/S do publikowania instrukcji zatwierdzonych i wydanych przez producenta.

© 2016, 2018 GN Otometrics A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. ® Otometrics, ikona Otometrics, AURICAL, MADSEN, ICS i HORTMANN są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy GN Otometrics A/S w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Data premiery wersji

03.04.2018 (182438)

Pomoc techniczna

Należy skontaktować się z dostawcą.

Spis treści

1	Przegląd	4
2	Przeznaczenie	5
3	Rozpakowywanie	6
4	Instalacja	6
5	Sondy Zodiac	8
6	Badania specjalne	14
7	Badanie przy użyciu urządzenia Zodiac Diagnostic lub Clinical — Wersja komputerowa ...	14
8	Drukowanie wyników badań z oprogramowania OTOSuite	32
9	Rozwiązywanie problemów	32
10	Serwis, czyszczenie i kalibracja	32
11	Specyfikacje techniczne	38
12	Normy i ostrzeżenia	49
13	Informacje dodatkowe	52
14	Producent	53

1 Przegląd

MADSEN Zodiac to kompaktowe urządzenie do badania immitancji.

MADSEN Zodiac Diagnostic i Clinical - Wersja komputerowa



Zobacz [Badanie przy użyciu urządzenia Zodiac Diagnostic lub Clinical — Wersja komputerowa](#) ► 14

Obsługa MADSEN Zodiac

Komputerową wersję urządzenia Zodiac można obsługiwać przy użyciu klawiatury i myszy komputera PC, z modulem tympanometrii OTOSuite pełniącym rolę wyświetlacza.

Sondy

Urządzenie MADSEN Zodiac obsługuje następujące sondy:

- Sonda ręczna Quick Check
- Dwa typy sond diagnostycznych — Classic i Comfort
- Kontralateralna słuchawka douszna lub TDH-39.

Obsługiwane badania

W zależności od konfiguracji Zodiac obsługuje następujące badania i funkcje:

- tympanometria,
- Screening odruchów
- Próg odruchu
- Zanik odruchu
- ETF-I (Działanie trąbki Eustachiusza — nienaruszona)
- ETF-P (Działanie trąbki Eustachiusza — perforowana)
- Rejestrowanie admitancji (wiele zastosowań, na przykład ocena szerokiej trąbki Eustachiusza, odruch strzemiączkowy z bodźcem zewnętrznym)
- Tympanometria ręczna

Połączenie MADSEN Zodiac — OTOSuite

Urządzenie MADSEN Zodiac zostało zaprojektowane do pracy z modulem tympanometrycznym OTOSuite. Moduł tympanometrii OTOSuite, który jest zgodny z systemem NOAH, umożliwia wykonywanie badań, monitorowanie wyników badań, tworzenie badań użytkownika, zapisywanie i eksportowanie danych oraz drukowanie raportów.

NOAH

System NOAH jest produktem firmy HIMSA służącym do zarządzania klientami/pacjentami, uruchamiania aplikacji do badania słuchu i oprogramowania dopasowującego oraz zapisywania wyników badań audiologicznych. Wyniki badań

MADSEN Zodiac można zapisywać w bazie danych systemu NOAH za pośrednictwem OTOSuite.

2 Przeznaczenie

MADSEN Zodiac to tester impedancji słuchowej, przeznaczony do zmiany ciśnienia powietrza w zewnętrznym przewodzie słuchowym oraz do zmierzenia i wykreślenia charakterystyki ruchomości błony bębenkowej w celu oceny stanu funkcjonalnego ucha środkowego. Urządzenie to służy również do pomiaru progu odruchu strzemiączkowego oraz badania zaniku, a także do badania działania trąbki Eustachiusza w przypadku nienaruszonej i perforowanej błony bębenkowej.

Użytkownicy: audiolodzy, laryngolodzy i inni pracownicy służby zdrowia przeszkoleni w badaniu noworodków, dzieci i dorosłych.

Zastosowanie: kliniczne, diagnostyczne oraz przesiewowe pomiary tympanometryczne i pomiary odruchów.

W urządzeniu MADSEN Zodiac zastosowano technologie o wysokiej skuteczności w badaniach klinicznych i przesiewowych. Pomiary tympanometryczne i pomiary odruchu strzemiączkowego mierzą mechaniczną reakcję ucha środkowego i stanowią podstawę do oceny, czy powiązane struktury fizjologiczne działają poprawnie.

Przeciwwskazania

Ostrzeżenie • Jeśli pacjent odczuwa dyskomfort podczas badania, zatrzymaj badanie. Badanie zostanie natychmiast przerwane. Wyniki już zmierzone są zachowywane.

Ostrzeżenie • Spójrz w przewód słuchowy. Zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie otoskopii w celu oceny stanu ucha zewnętrznego przed wprowadzeniem sondy. Jeśli przewód słuchowy jest zablokowany, może to wpłynąć na wynik badania. W razie potrzeby należy wyczyścić przewód słuchowy. Po wyczyszczeniu lub usunięciu wosku należy się upewnić, że w uchu pacjenta nie pozostał płyn.

Ostrzeżenie • W przypadku pacjentów wykazujących następujące objawy nie należy wykonywać badań bez uzyskania zgody lekarza:

- Występuje wysięk z ucha.
- Pacjent przeszedł niedawno zabieg chirurgiczny na uchu środkowym.
- Przewód słuchowy jest niedrożny.
- Pacjent cierpi z powodu ostrego urazu.
- Pacjent doświadcza poważnego dyskomfortu.
- Pacjent wykazuje objawy szumów usznych lub nadwrażliwości na dźwięki — w takim przypadku należy unikać używania nadmiernie głośnych bodźców dźwiękowych przy pomiarach odruchu strzemiączkowego.

2.1 Konwencje typograficzne

Użycie symboli **Ostrzeżenie**, **Zachować ostrożność** oraz **Uwaga**

W podręczniku są używane następujące symbole ostrzegawcze w celu zwrócenia uwagi na informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego używania urządzenia lub oprogramowania:

Ostrzeżenie • Oznacza, że występuje ryzyko śmierci lub odniesienia poważnych obrażeń przez użytkownika lub pacjenta.

Zachować ostrożność • Oznacza, że występuje ryzyko odniesienia obrażeń przez użytkownika lub pacjenta bądź ryzyko uszkodzenia danych lub urządzenia.

Uwaga • Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę.

Aby uzyskać bezpłatny wydruk dokumentacji użytkownika, należy skontaktować się z firmą Otometrics (www.otometrics.com).

3 Rozpakowywanie

1. Ostrożnie rozpakuj urządzenie.
Po rozpakowaniu urządzenia i akcesoriów zaleca się pozostawienie oryginalnego opakowania. W przypadku konieczności transportowania urządzenia z przyczyn technicznych oryginalne opakowanie będzie stanowić ochronę przed uszkodzeniami.
2. Obejrzyj urządzenie i sprawdź, czy nie doszło do żadnych uszkodzeń.
W przypadku ich wystąpienia nie uruchamiaj urządzenia i skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.
3. Sprawdź kompletność dostawy na podstawie wykazu, aby się upewnić, że dotarły wszystkie niezbędne części i akcesoria.
Jeśli się okaże, że zestaw jest niekompletny, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

4 Instalacja

Aby zapewnić bezpieczną obsługę urządzenia, należy się upewnić, że urządzenie MADSEN Zodiac zostało poprawnie zainstalowane i są spełnione wymagania wymienione ostrzeżeniach.

Zobacz [Ostrzeżenia](#) ► 50.

Lokalizacja

Zachować ostrożność • Praca w temperaturze poniżej -20°C (-4°F) i powyżej $+60^{\circ}\text{C}$ (140°F) może spowodować trwałe uszkodzenia.

Badaniu immitancji sprzyja pomieszczenie o stosunkowo niskim poziomie hałasu. Nie jest wymagana kabina dźwiękowa ani pomieszczenie dźwiękoszczelne.

Montaż w uchwycie ściennym

Informacje na temat montowania urządzenia MADSEN Zodiac na ścianie zawierają instrukcje dołączone do zestawu montażu na ścianie.

Sonda

W momencie dostawy sonda jest już podłączona do urządzenia MADSEN Zodiac.

Dotyczy to też sytuacji, gdy konfiguracja obejmuje zarówno sondę Quick Check, jak i sondę diagnostyczną.

Zalecamy codzienne sprawdzanie sondy w celu potwierdzenia poprawności pomiarów systemu.

Uwaga • Jeśli wartość wyniku sprawdzania sondy nie mieści się w przedziale $1,9\text{--}2,1\text{ mmho/cc/cm}^3/\text{ml}$ przy 226 Hz , zalecamy przeprowadzenie kalibracji admitancji. Zobacz Poszerzona instrukcja Zodiac.

Uchwyt na sondę

Uchwyt na sondę można zamontować na ścianie przy użyciu opcjonalnego zestawu do montażu ściennego sondy.

Zasilanie

- Zobacz [Zasilanie urządzenia](#) ► 7.

4.1 Zasilanie urządzenia

Urządzenie Zodiac jest zasilane za pomocą zewnętrznego zasilacza podłączanego bezpośrednio do gniazdka sieciowego.

Zachować ostrożność • Należy używać tylko zasilacza określonego w części [Specyfikacje techniczne](#) ► 38.

Podłączanie zasilacza zewnętrznego do urządzenia Zodiac



1. Podłącz końcówkę kabla zasilacza zewnętrznego z wtyczką do gniazda zasilania zewnętrznego z tyłu urządzenia.

Podłączanie zasilacza zewnętrznego do gniazdka sieciowego



1. Podłącz wtyczkę sieciową zasilacza zewnętrznego bezpośrednio do gniazda sieciowego prądu przemiennego z linią uziemiającą.
2. Jeśli to konieczne, włącz zasilanie.

Pierwsze włączenie urządzenia

Uwaga • Przy pierwszym włączeniu urządzenia należy pozostawić je włączone przez co najmniej godzinę, aby umożliwić naładowanie baterii zegara.

Przy pierwszym włączeniu urządzenia, lub jeśli urządzenie nie było włączane przez okres dłuższy niż dwa tygodnie, bateria wewnętrzного zegara jest wyczerpana. Podczas uruchamiania urządzenia pojawi się monit od ręczne ustawienie czasu.

- Ustaw odpowiednio datę i godzinę na urządzeniu.
- Możesz także połączyć się z oprogramowaniem OTOSuite, w którym czynność ta zostanie wykonana automatycznie.

Włączanie i wyłączanie urządzenia MADSEN Zodiac

1. Aby włączyć urządzenie Zodiac, naciśnij przycisk **Włącz/Wyłącz**.
 - W przypadku komputerowych wersji urządzenia wskaźnik **Włącz/Wyłącz** zaświeci na zielono.
2. Aby wyłączyć urządzenie Zodiac, naciśnij przycisk **Włącz/Wyłącz**.

W razie potrzeby wyłącz zasilanie i odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego.



4.2 Podłączenie urządzenia do komputera

Aby podłączyć urządzenie Zodiac do komputera, należy zainstalować na nim oprogramowanie OTOSuite.

Instrukcje instalacji OTOSuite zawiera OTOSuite Podręcznik instalacji na nośniku instalacyjnym OTOSuite.

Zachować ostrożność • Należy używać jedynie kabla USB dostarczonego z urządzeniem Zodiac.



Podłącz kabel USB z gniazda USB z tyłu urządzenia do gniazda USB komputera PC. Moduł tympanometrii OTOSuite automatycznie wykryje urządzenie.

5 Sondy Zodiac

Ostrzeżenie • Zbadaj ucho pacjenta. Spójrz w przewód słuchowy. Zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie otoskopii w celu oceny stanu ucha zewnętrznego przed wprowadzeniem sondy. Jeśli przewód słuchowy jest zablokowany, może to wpłynąć na wynik badania. W razie potrzeby należy wyczyścić przewód słuchowy. Upewnij się, że po wyczyszczeniu lub usunięciu wosku w uchu pacjenta nie pozostaje płyn.

Ostrzeżenie • Końcówkę uszną można stosować każdym uchu. W przypadku podejrzenia zakażenia w jednym uchu należy użyć czystej końcówki usznej i końcówki sondy przed kontynuowaniem badania drugiego ucha.


Środki ochrony higienicznej

- Należy postępować zgodnie z ustalonymi procedurami zapobiegania zakażeniom, które są odpowiednie dla danego otoczenia.
- Należy zawsze używać czystych końcówek usznych.
- Aby zapobiec zakażeniom krzyżowym, do badania następnej osoby należy użyć nowych końcówek do uszu.

5.1 Sonda urządzenia Quick Check

W stosownych przypadkach urządzenie Zodiac jest dostarczane z już podłączoną sondą Quick Check.

- A. Korpus sondy
- B. Przycisk **Ucho**
 - Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę badanego ucha.
- C. Wskaźnik świetlny pokazuje kolor wybranego badanego ucha oraz stan szczelności.

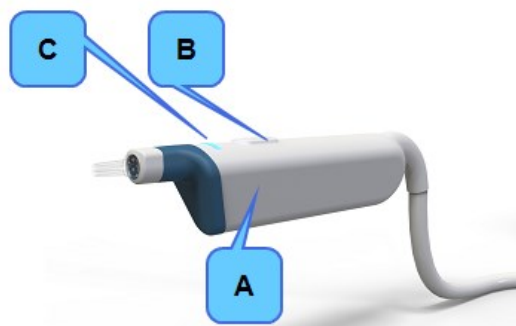

Korzystanie z sondy

- [Mocowanie końcówki usznej na sondzie](#) ► 19
- [Czyszczenie sondy i końcówki sondy](#) ► 34

Ostrzeżenie • Przed włożeniem sondy do ucha pacjenta należy zawsze założyć na nią końcówkę uszną.

Ostrzeżenie • Końcówkę uszną można stosować każdym uchu. W przypadku podejrzenia zakażenia w jednym uchu należy użyć czystej końcówki usznej i końcówki sondy przed kontynuowaniem badania drugiego ucha.

Trzymanie sondy

- Chwyt od dołu



- Chwyt od góry



Rozpoczynanie badania

Badanie rozpoczyna się automatycznie po delikatnym wciśnięciu końcówki usznej do badań przesiewowych do przewodu słuchowego i uzyskaniu uszczelnienia.

Zatrzymywanie badania

Badanie można zatrzymać, wyjmując sondę z badanego ucha.

5.2 Sondy diagnostyczne

W zależności od konfiguracji urządzenia, urządzenia Zodiac Diagnostic i Zodiac Clinical są dostarczane z podłączoną sondą diagnostyczną.

Sonda diagnostyczna jest dostępna w dwóch wersjach.



Sonda urządzenia Classic



Sonda urządzenia Comfort

Ostrzeżenie • Przed włożeniem sondy do ucha pacjenta należy zawsze założyć na nią końcówkę uszną.

Typy sond

Sonda urządzenia Quick Check ► 9

Sonda diagnostyczna i opaska na ramię ► 11

Korzystanie z sondy

- Używanie dwóch sond z urządzeniem ► 12
- Mocowanie końcówki usznej na sondzie ► 19
- Wkładanie sondy do ucha pacjenta ► 20
- Czyszczenie sondy i końcówki sondy ► 34

5.2.1 Sonda diagnostyczna i opaska na ramię

Sonda diagnostyczna jest podłączana do opaski na ramię sondy.

Ostrzeżenie • Przed włożeniem sondy do ucha pacjenta należy zawsze założyć na nią końcówkę uszną.




Sonda urządzenia Classic




Sonda urządzenia Comfort

Opaska na ramię

Opaska na ramię to elastyczna opaska przeznaczona na ramię pacjenta. Utrzymuje ona kable sondy diagnostycznej na miejscu podczas badania, dzięki czemu na wyniki pomiarów nie wpływają szumy tła.

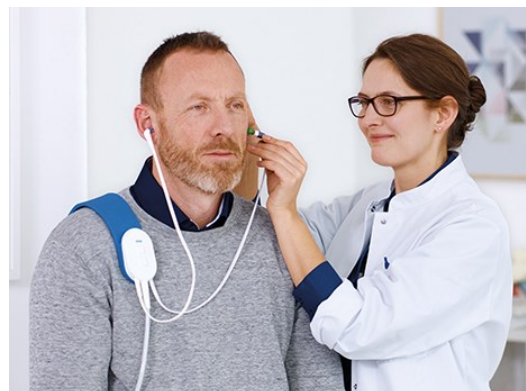


- A. Opaska na ramię
- B. Otwór do zawieszania opaski na ramię
- C. Sonda diagnostyczna
- D. Kontroler
- E. Słuchawka kontralateralna
- F. Połączenia kabla sondy

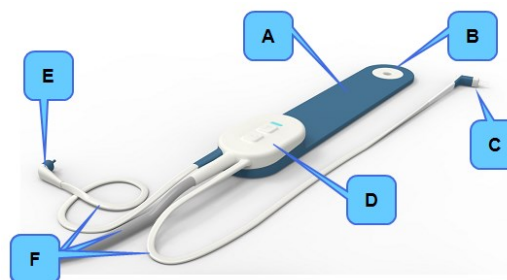

Połączenia kabla sondy

- A. Połączenie sondy diagnostycznej
Sonda diagnostyczna jest połączona na stałe z kontrolerem.
- B. Kabel połączeniowy
Kabel połączeniowy zapewnia połączenie sondy diagnostycznej z urządzeniem Zodiac.
- C. Gniazdo połączeniowe słuchawki kontralateralnej
W razie potrzeby podłącz słuchawkę kontralateralną do tego gniazda.

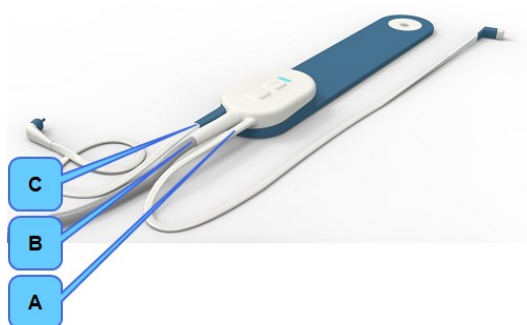

Kontroler sondy


Kontroler to element opaski na ramię.

- A. Wskaźnik świetlny pokazuje kolor wybranego badanego ucha oraz stan sondy.
- B. Przycisk **Ucho**.
 - Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę badanego ucha.
- C. Przycisk **Uruchom/Zatrzymaj**
Naciśnij ten przycisk, by uruchomić lub zatrzymać badanie.



Sonda diagnostyczna

- A. Wskaźnik świetlny pokazuje kolor wybranego badanego ucha, stan sondy oraz stan szczelności.
- B. Korpus sondy
- C. Pierścień sondy
- D. Końcówka sondy

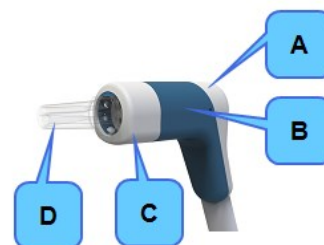

5.2.2 Używanie dwóch sond z urządzeniem

Jeśli odpowiednia sonda nie jest aktywowana, naciśnij dowolny przycisk na sondzie w celu jej aktywowania.


5.3 Słuchawka kontralateralna

Aby przebadać odruch kontralateralny, należy użyć słuchawki kontralateralnej w celu zaprezentowania bodźca do ucha bez sondy.

Podłączanie słuchawki kontralateralnej

- W razie potrzeby podłącz słuchawkę kontralateralną do tego gniazda na kontrolerze.

Mocno wcisnąć wtyczkę do gniazda, aż zablokuje się na miejscu.

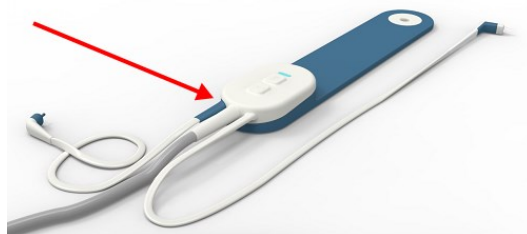

Odłączanie słuchawki kontralateralnej

- Aby odłączyć słuchawkę kontralateralną, chwycić wzmocnioną tuleję wtyczki i pociągnij mocno do momentu odłączenia wtyczki.

Słuchawka douszna

Zachować ostrożność • Nigdy nie należy wkładać słuchawki kontralateralnej do ucha pacjenta bez wcześniejszego zbadania przewodu słuchowego pacjenta.

Ostrzeżenie • Końcówkę uszną można stosować każdym uchu. W przypadku podejrzenia zakażenia w jednym uchu należy użyć czystej końcówki usznej i końcówki sondy przed kontynuowaniem badania drugiego ucha.

Ostrzeżenie • Nie należy używać dousznej słuchawki kontralateralnej w uchu z wysiękiem. Należy w zamian zastosować słuchawkę nauszną.

Ostrzeżenie • Aby zapobiec zakażeniom krzyżowym, do badania następnej osoby należy użyć nowych końcówek do uszu.

- Nałóż końcówkę piankową o odpowiednim rozmiarze na douszną słuchawkę kontralateralną.
- Przed włożeniem końcówki usznej do ucha pacjenta ściśnij piankę, aby ją zmniejszyć. Włóż końcówkę uszną do ucha pacjenta, tak aby zewnętrzna powierzchnia końcówki była wyrównana z wejściem przewodu słuchowego.
W ciągu kilku sekund końcówka uszna rozszerzy się w przewodzie słuchowym.



Słuchawka nauszna

1. Załóż słuchawkę nauszną na głowę pacjenta, tak aby środek słuchawki był skierowany w stronę wejścia przewodu słuchowego.

Zachować ostrożność • Niektóre przewody słuchowe mogą się zapisać, co uniemożliwia wejście bodźca do ucha. W takich przypadkach należy użyć słuchawki dousznej lub postępować zgodnie z lokalnymi zaleceniami.

6 Badania specjalne

Zodiac może wykonywać kilka specjalnych badań immitancji, takich jak ETF-P czy tympanometria ręczna.

Szczegółowy opis tych badań zawiera Zodiac Poszerzona Instrukcja.

7 Badanie przy użyciu urządzenia Zodiac Diagnostic lub Clinical — Wersja komputerowa

W przypadku używania oprogramowania OTOSuite do badań przy użyciu urządzenia MADSEN Zodiac Diagnostic lub Clinical można wykonać badanie tympanometryczne i zaawansowane typy badań odruchów. Szczegółowe opisy tych badań zawiera MADSEN Zodiac Poszerzona Instrukcja.

Wybieranie typu badania

- W module tympanometrii OTOSuite kliknij odpowiednią kartę badania.

Wybór ustawień

- W razie potrzeby zmień ustawienia badania w panelu sterowania lub w oknie **Narzędzia** (Tools) > **Opcje** (Options).

Rozpoczynanie badania

- Kliknij przycisk **Uruchom** lub **Prezentuj**.



Zatrzymywanie badania

- Badanie zakończy się automatycznie. Jeśli jednak badanie jest dla pacjenta nieprzyjemne, zatrzymaj je, klikając przycisk **Zatrzymaj** lub wyjmując sondę z ucha pacjenta.



7.1 Ikony na pasku narzędzi i panelach sterowania oprogramowania OTOSuite


Ikony ogólnego paska narzędzi

Szczegółowy opis zawiera OTOSuite Instrukcja obsługi.



Przykład ekranu badania

Tympanometria i badanie przesiewowe odruchu — wersja Diagnostic i Clinical

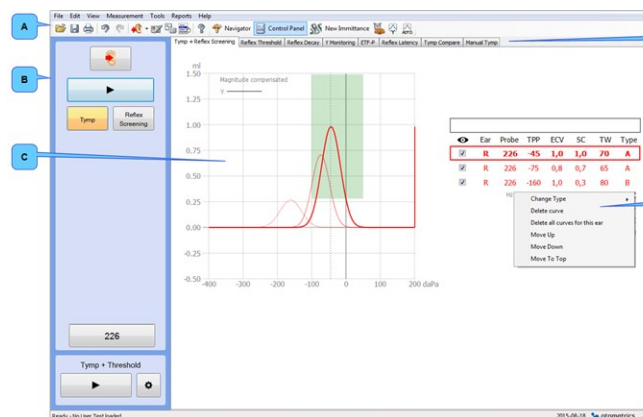







- A. Rozpoczynanie i kończenie sesji
- B. Wybór pomiarów i przeprowadzanie badań
- C. Wyświetlanie danych badania
- D. Edycja wyników
- E. Wybór innych typów badań





Rozpoczynanie i kończenie sesji


Ikony paska narzędzi	
Ikony wyświetlane na pasku narzędzi zależą od wybranej funkcji badania.	
	Edytuj szczegóły klienta (Edit client details) <ul style="list-style-type: none"> Kliknij, aby utworzyć nową sesję.
	Drukuj raport domyślny (Print default report) <ul style="list-style-type: none"> Kliknij, aby wydrukować domyślny raport z badań dla bieżącego pacjenta.
	Sprawdzanie sondy (Probe Check) <ul style="list-style-type: none"> W razie potrzeby kliknij, aby przeprowadzić sprawdzanie sondy.



Wybór pomiarów


Aktywacja i dezaktywacja funkcji badań	
 	Aktywacja funkcji badań <ul style="list-style-type: none"> Kliknij, aby aktywować badanie lub ustawienie badania, których chcesz użyć. Przycisk zmienia kolor na żółty, wskazując aktywowanie funkcji.
 	Dezaktywacja funkcji badań <ul style="list-style-type: none"> Kliknij, aby dezaktywować badanie lub ustawienie badania, których nie chcesz używać. Przycisk zmienia kolor na szary, wskazując dezaktywowanie funkcji.


Tymp. i bad. przesiew. odruchu (Tymp. and Reflex Scr.)	
	Tympanometria (Tymp) (tympanometria) <ul style="list-style-type: none"> Kliknij, aby wybrać badanie Tympanometria (Tymp).
	Badanie przesiewowe odruchu (Reflex Screening) <ul style="list-style-type: none"> Kliknij, aby dodać Badanie przesiewowe odruchu (Reflex Screening) do badania Tympanometria (Tymp).


   	Częstotliwości badania przesiewowego odruchu (Hz) <ul style="list-style-type: none"> Kliknij, aby wybrać odpowiednie częstotliwości czystych tonów dla pomiaru badania przesiewowego odruchu: <ul style="list-style-type: none"> – 0,5 kHz – 1 kHz – 2 kHz – 4 kHz
--	---


	Szum (Noise) - — bodziec szumu badania przesiewowego odruchu <ul style="list-style-type: none"> Kliknij, aby wybrać szum szerokopasmowy jako bodziec odruchu.
---	---


Próg odruchu (Reflex Threshold), Zanik odruchu (Reflex Decay), Latencja odruchu (Reflex Latency)	
	Ipsi (Ipsi) (ipsilateralne) <ul style="list-style-type: none"> Kliknij, aby wybrać stronę prezentacji bodźca dla badania odruchu ucha z sondą.
	Kontra (Contra) (kontralateralne) <ul style="list-style-type: none"> Kliknij, aby wybrać prezentację bodźca w uchu bez sondy.


	<p>± P (± P) (przesunięcie ciśnienia docelowego od TPP)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kliknij odpowiednią strzałkę, by wybrać przesunięcie ciśnienia w celu ustabilizowania błony bębenkowej.
---	--

	<p>Ustaw typ bodźca</p> <ul style="list-style-type: none"> Kliknij odpowiednią strzałkę, aby ustawić typ bodźca.
---	--


	<p>Ustaw poziom bodźca</p> <ul style="list-style-type: none"> Kliknij odpowiednią strzałkę, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom bodźca.
---	---

	<p>Ręczne (Manual)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kliknij, aby wybrać ręczne wyszukiwanie progu odruchu. Każdy bodziec będzie prezentowany oddzielnie.
---	--


	<p>Automatyczne (Auto)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kliknij, aby wybrać automatyczne wyszukiwanie progu odruchu. Bodźce będą prezentowane w sekwencji.
---	--








	<p>Ton sondy</p> <ul style="list-style-type: none"> Kliknij, aby wybrać żądany ton sondy w Hz: <ul style="list-style-type: none"> – 226 – 768 (tylko wersja Clinical) – 800 (tylko wersja Clinical) – 1000
--	---

Tymp. ręczna (Manual Tymp)








	<p>Rozpocznij rejestrowanie tympanometrii ręcznej</p> <ul style="list-style-type: none"> Kliknij, aby rozpocząć rejestrowanie. Następnie użyj suwaka poniżej wykresu do sterowania pompą.
---	---


Badania sekwencyjne

	<p>Automatyczne badania sekwencyjne</p> <p>Ta funkcja umożliwia łączenie kilku pomiarów diagnostycznych i uruchamianie ich jako sekwencji automatycznej.</p> <p>Naciśnięcie przycisku Start (Start) powoduje wykonanie wszystkich funkcji wybranych w ramach sekwencji: np. tympanometria + Progi odruchu ipsi i kontra przy różnych częstotliwościach.</p> <p>Istnieje możliwość zmiany dowolnych ustawień związanych z badaniami ujętymi w sekwencji.</p> <p>Można wybrać, czy mają być uruchamiane sekwencje, czy pojedyncze badania za pomocą kontrolera na opasce na ramię.</p>
---	--

Uruchomione badania	
  	<p>Ucho (Ear)</p> <p>Ten przycisk znajduje się w panelu sterowania i na sondach.</p> <p>Kliknij lub naciśnij ten przycisk, aby zmienić wybór ucha powiązany z bieżącym pomiarem. Przycisk przybierze kolor odpowiadający wybranemu uchu.</p>
 	<p>Uruchom/Zatrzymaj (Start/Stop)</p> <p>Ten przycisk znajduje się w panelu sterowania i na opasce na ramię sondy diagnostycznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kliknij lub naciśnij ten przycisk, aby wykonać pomiar tympanometryczny i rozpocząć badania odruchu (oraz dodatkowo zaprezentować bodźce do ręcznego badania odruchu). • Podczas badania kliknij lub naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać badanie.
	<p>Ręczna prezentacja bodźca</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kliknij, aby utworzyć ręczny próg odruchu.
	<p>Rozpocznij rejestrowanie (rejestrowanie admitancji)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kliknij, aby rozpocząć rejestrowanie zmian admitancji.

Wyświetlanie danych badania

Tympanogram	
 	<p>Przełącz, aby wyświetlać tympanogram w trybie dwuosobnym lub jednospobnym.</p>
	<p>Wczytaj dane z urządzenia.</p>
   	<p>Przełączaj, aby wyświetlić składowe admitancji — konduktancję i susceptancję — lub dane admitancji.</p> <p>Wybrano admitancję (Admittance is selected)</p> <p>Wybrano susceptancję/konduktancję (Susceptance/Conductance is selected)</p> <p>Wybrano susceptancję (Susceptance is selected)</p> <p>Wybrano konduktancję (Conductance is selected)</p>

Tympanogram	
	<p>Autoskalowanie (Auto Scale) (tympanogram)</p> <p>Kliknij, aby zaznaczyć/usunąć zaznaczenie autoskalowania tympanogramu w celu wyświetlenia całej krzywej. Zmiana ucha lub pacjenta powoduje przywrócenie skali domyślnej.</p>

Wybór innych typów badań

Karty typów badań	<p>Kliknij, aby wybrać odpowiedni typ badania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tymp. i bad. przesiew. odruchu (Tymp. and Reflex Scr.) • Próg odruchu (Reflex Threshold) • Rejestrowanie admitancji (Admittance Recording) • ETF-P (ETF-P) • Tymp. ręczna (Manual Tymp)
--------------------------	---

7.2 Tworzenie nowej sesji

- Utwórz nową sesję w oprogramowaniu OTOsuite.



- Aby przebadać nowego pacjenta, kliknij w celu otwarcia okna **Szczegóły klienta** (Client Details), a następnie kliknij opcję **Nowa sesja** (New Session).

Spowoduje to zamknięcie zestawu danych bieżącego pacjenta i umożliwi zapisanie danych dla nowego pacjenta.

7.3 Używanie konfiguracji badania

W OTOsuite

Można wybrać konfigurację badania inną niż wybrana obecnie.



- Kliknij, aby otworzyć okno **Selektor badania** (Test Selector). W tym oknie można ładować badania zdefiniowane przez użytkownika, specjalne konfiguracje badań i domyślne badania fabryczne.

7.4 Mocowanie końcówki usznej na sondzie

Sonda urządzenia Quick Check

- Zalecamy stosowanie z sondą Quick Check za dużych końcówek.

Sonda diagnostyczna

Założ końcówkę uszną na sondę.

Mocowanie końcówki usznej na sondzie



1. Mocno wciśnij i wkręć końcówkę uszną na końcówkę sondy, tak aby oparła się mocno na podstawie końcówki sondy.

Zdejmowanie końcówki

- Aby zdjąć końcówkę uszną, chwyć jej trzon i ściągnij ją prostym ruchem z końcówki sondy.

7.5 Wkładanie sondy do ucha pacjenta

1. Spójrzij w przewód słuchowy. Zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie otoskopii w celu oceny stanu ucha zewnętrznego przed wprowadzeniem sondy.
2. Jeśli przewód słuchowy jest zablokowany, może to wpłynąć na wynik badania. W razie potrzeby należy wyczyścić przewód słuchowy.

Zachować ostrożność • Dostanie się cieczy do sondy może spowodować jej uszkodzenie.

Ostrzeżenie • W żadnym wypadku nie należy umieszczać końcówki sondy w przewodzie słuchowym nowego pacjenta bez uprzedniego nałożenia czystej końcówki usznej.

Ostrzeżenie • Końcówkę uszną można stosować każdym uchu. W przypadku podejrzenia zakażenia w jednym uchu należy użyć czystej końcówki usznej i końcówki sondy przed kontynuowaniem badania drugiego ucha.

Zachować ostrożność • Należy zawsze używać końcówek usznych o właściwym rozmiarze. Zastosowanie sondy z końcówką o niewłaściwym rozmiarze lub zastosowanie nadmiernej siły może spowodować niepotrzebny dyskomfort pacjenta.

Dopasowywanie sondy do ucha

1. W przypadku sondy ręcznej można użyć nieco za dużej końcówki usznej w celu uzyskania uszczelnienia, gdy sonda jest używana z szerszym zakresem rozmiarów przewodu słuchowego.
Użycie większej końcówki usznej ma zapobiec wejściu końcówki do przewodu słuchowego.
2. Załóż końcówkę uszną na sondę.

3. Załóż opaskę na ramię na ramię pacjenta.
4. Aby ustabilizować sondę i uniknąć blokowania sondy o przewód słuchowy pacjenta, chwyć małżowinę uszną i delikatnie odciągnij ją do tyłu i nieznacznie od głowy pacjenta.
 - Dla dorosłych: odciągnij małżowinę uszną do góry i do tyłu.
 - Dla dzieci i niemowląt: odciągnij małżowinę uszną w dół i do tyłu.
5. Wprowadź sondę do przewodu słuchowego pacjenta, lekko ją obracając. Po umieszczeniu sondy w odpowiednim miejscu ostrożnie wyciągnij dłoń.
6. Upewnij się, że końcówka uszna jest dobrze dopasowana. Zminimalizuje to ryzyko zablokowania końcówki sondy o ścianę przewodu słuchowego. Płaski tympanogram w połączeniu z nietypowo małą objętością przewodu słuchowego (ECV) wskazuje na zablokowanie sondy.

Pomiar nie rozpocznie się automatycznie, jeśli odczyt objętości przewodu słuchowego jest mniejszy niż 0,1.
7. Każda nieszczelność spowoduje przerwanie badania. Sonda wskaże obecność nieszczelności.

Umieszczanie sondy diagnostycznej



Stan sondy i nieszczelność

Wskaźniki świetlne

Wskaźniki świetlne świecą się w kolorze na sondzie w celu poinformowania o różnych stanach. W przypadku stosowania sondy diagnostycznej kontroler na opasce na ramię pokazuje cały czas kolor wybranego ucha.

Kolor sondy	Stan
Czerwona	<ul style="list-style-type: none"> • Wybrano badanie prawego ucha • Urządzenie jest w trybie bezczynności
Niebieski	<ul style="list-style-type: none"> • Wybrano badanie lewego ucha • Urządzenie jest w trybie bezczynności
Zielony	<ul style="list-style-type: none"> • Badanie zostało uruchomione
Żółty	<ul style="list-style-type: none"> • Nieszczelność


Oznaczenia w oprogramowaniu OTOsuite

Kolor	Stan
Zielony	<ul style="list-style-type: none"> Podczas pomiarów OTOsuite wyświetla zielone tło dla wartości online.

Nieszczelność sondy

Jeśli podczas badania wystąpi nieszczelność sondy, zostanie to wskazane na ekranie OTOsuite.

Jeśli używasz sondy Quick Check, wskazanie nieszczelności pozostanie na ekranie, aż wyjmiesz sondę z ucha i spróbujesz ponownie.



Sonda zablokowana

Jeśli podczas badania sonda jest zablokowana, zostanie to wskazane na ekranie OTOsuite.

Jeśli używasz sondy Quick Check, wskazanie zablokowania sondy pozostanie na ekranie, aż wyjmiesz sondę z ucha i spróbujesz ponownie.




7.6 Badania sekwencyjne

Badania immitancji można wykonywać w sekwencji.

- W obszarze **Sekwencja** (Sequence) panelu sterowania kliknij przycisk **Opcje sekwencji** (Sequence Options), aby wybrać badania i określone ustawienia.
- Kliknij pola wyboru obok badań, które chcesz uwzględnić w sekwencji.
- W razie potrzeby zmodyfikuj ustawienia odruchu, które chcesz uwzględnić w sekwencjach testów automatycznych.



Uwaga • Możesz wybrać opcję uruchamiania sekwencji bezpośrednio za pomocą przycisku **Start** (Start) na kontrolerze na opasce na ramię.

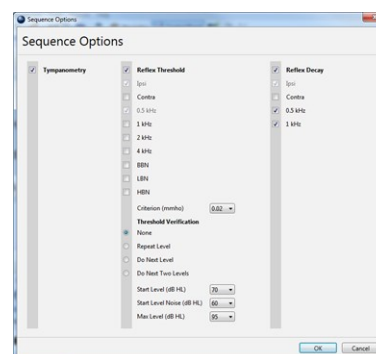

7.7 tympanometria,

Tympanogram można zarejestrować jako osobny pomiar albo w ramach sekwencji diagnostycznej lub przesiewowej. W przypadku sekwencji po tympanometrii jest automatycznie wykonywane badanie odruchu.

Poniżej zamieszczono opis wykonywania tympanometrii jako pojedynczego badania. Oznacza to, że funkcja sekwencji jest wyłączona.

Włączanie sondy

Jeśli sonda nie jest aktywowana (wskaźnik sondy nie świeci się), aktywuj sondę:


- Sonda diagnostyczna: Naciśnij przycisk **Ucho** (Ear) na urządzeniu Zodiac lub przycisk **Uruchom/Zatrzymaj** (Start/Stop) na kontrolerze.
- Sonda Quick Check: Naciśnij przycisk **Ucho** (Ear) na sondzie.



Sonda zaświeci się w kolorze ucha, wskazując aktywację.

Rozpoczynanie badania

1. Kliknij przycisk **Tympanometria** (Tymp) na panelu sterowania. Upewnij się, że jest wybrany tylko przycisk **Tympanometria** (Tymp).
2. Umieść sondę w uchu pacjenta.
3. Poproś pacjenta, aby podczas badania siedział nieruchomo i cicho oraz aby nie wykonywał ruchów głową ani szczęką.
4. Kliknij przycisk **Start** (Start), aby rozpocząć badanie.



Mała zielona kropka w rogu przycisku Uruchom oznacza, że badanie można uruchomić zdalnie za pomocą przycisku sondy. W razie potrzeby zaznacz opcję **Narzędzia > Opcje** (Tools > Options), aby zmienić to ustawienie.

Zatrzymywanie badania

Badanie zostanie zatrzymane automatycznie, ale w razie potrzeby można je też zatrzymać ręcznie.


1. Kliknij przycisk **Zatrzymaj** (Stop) w panelu sterowania lub przycisk **Uruchom/Zatrzymaj** (Start/Stop) na sondzie.
2. Badanie zostanie natychmiast przerwane.

Wykonywanie nowego przemiatania tympanometrii

1. Aby wykonać nowe przemiatanie, kliknij przycisk **Uruchom**.
Aby zastąpić tympanogram, zaznacz krzywą do zastąpienia w tabeli wyników.

7.7.1 Ekran tympanometrii

Po rozpoczęciu pomiaru jego wyniki są przedstawiane w czasie rzeczywistym na ekranie.

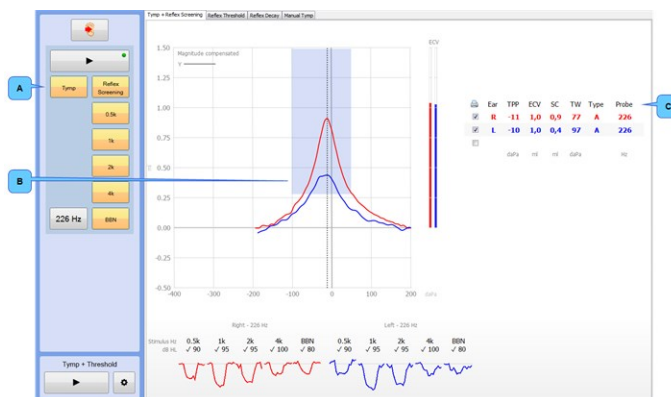

- A. Opcje na panelu sterowania
- B. Wykres tympanometrii
- C. Tabela wyników

A. Opcje na panelu sterowania

Typ pomiaru i ton sondy w Hz.

B. Wykres tympanometrii

Obszar wykresu zawiera krzywe tympanometryczne, a jego skala zmienia się automatycznie zgodnie z krzywymi.

- Krzywe tympanometryczne
- Skale ciśnienia i admitancji
- Pasek objętości przewodu słuchowego
- **Obszar normy**

Objętość przewodu słuchowego jest przedstawiona na prawo od wykresu.

C. Tabela wyników

Tabela wyników zawiera wyniki związane z obecnie zaznaczoną krzywą. Po kliknięciu rzędu wyników odpowiednia krzywa jest podświetlana w obszarze wykresu tympanometrii.

Aby zamienić pojedynczy pomiar, usuń krzywą i dostosuj ustawienia pomiarów, aby wykonać ponownie pojedynczy pomiar.

- **Sprawdzanie sondy** (Probe check) (ton sondy w Hz)
- **TPP** (TPP) (szczytowe ciśnienie tympanometryczne)
- **ECV** (ECV) (równoważna objętość przewodu słuchowego)
- **SA** (SA) (admitancja statyczna) lub **SC** (SC) (podatność statyczna) w przypadku zastosowania równoważnych jednostek objętości.
- **TW/Współczynnik** (TW/Ratio) (szerokość tympanometryczna/współczynnik tympanometryczny). Opisuje stromiznę krzywej.
- **Typ** (Type) (typy Jerger A, As, Ad, B, C, D i E wskazują kształt krzywej 226 Hz). Typ można skonfigurować do automatycznego określania, a w razie potrzeby można go następnie zmienić.

Edycja wyników

Aby przeprowadzić edycję wyników w tabeli wyników, kliknij prawym przyciskiem myszy rząd pomiarów do edycji i wybierz pozycję z menu.

- **Przenieś w górę** (Move up)
- **Przenieś w dół** (Move down)
- **Ustaw jako podstawowe** (Set as Primary)
- **Zmień typ** (Change Type)
- **Zamień ucho...** (Swap Ear...)
- **Usuń krzywą** (Delete Curve)
- **Usuń wszystkie krzywe dla tego ucha** (Delete all curves for this ear)

7.8 Badanie ETF-I (Działanie trąbki Eustachiusza — nienaruszona)


Uwaga • To badanie jest dostępne tylko w przypadku, gdy urządzenie MADSEN Zodiac obsługuje badania diagnostyczne.

Procedura

Do tego badania zostaną użyte trzy wiersze wyników w tabeli wyników tympanometrii.

Jeśli chcesz je wydrukować, upewnij się, że wszystkie trzy badania są wybrane w tabeli wyników tympanometrii.

1. Wybierz ekran badania **Tymp. i bad. przesiew. odruchu** (Tymp. and Reflex Scr.).
2. Zarejestruj tympanogram.
3. Poinstruj pacjenta, aby wykonał próbę próbę Valsalvy lub próbę Toynbee.
4. Zarejestruj drugi tympanogram.
5. Porównaj tympanogramy z etapu od 1 do 3 na tympanogramie wielowarstwowym.
6. Przydatne może być powtórzenie procedury z wykorzystaniem różnych technik i prób w sekwencji badania w celu pełnej oceny działania trąbki Eustachiusza.

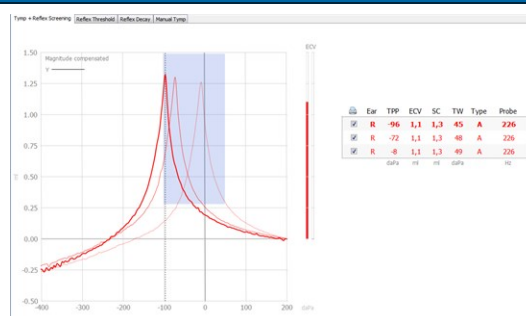

Uwaga • Do badania ETF-I można też użyć tympanometrii ręcznej. W tympanometrii ręcznej można ułatwić wykonywanie prób wyrównawczych przez utrzymywanie ciśnienia pomiędzy pomiarami.

7.9 Badanie odruchu strzemiączkowego

Urządzenie MADSEN Zodiac ustala automatycznie odruchy strzemiączkowe, stosując różne poziomy bodźców.

Uwaga • Przed wykonaniem pomiaru odruchu strzemiączkowego zalecane jest przeprowadzenie badania tympanometrycznego, a przed pomiarem zaniku odruchu zalecane jest ustalenie progu odruchu strzemiączkowego.

Poziomy o dużym natężeniu

Uwaga • Aby uniknąć przerywania badań automatycznych z powodu wysokich natężeń bodźca sięgających limitów ostrzegawczych, zalecane jest ustawienie maksymalnego natężenia na 100 dB HL. Jeśli zajdzie potrzeba, automatyczne pomiary odruchu możesz zawsze uzupełnić badaniem ręcznym.

Ostrzeżenie • Poziom ciśnienia akustycznego w przewodzie słuchowym rośnie w przypadku badania pacjentów o niewielkich przewodach słuchowych. Należy zawsze przestrzegać lokalnych praktyk i zaleceń dotyczących prezentowania głośnych bodźców.

Gdy poziom natężenia przekracza poziom ostrzegawczy (> 100 dB HL), zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy i pojawi się monit z pytaniem, czy kontynuować badanie czy przejść do następnego typu bodźca.

7.9.1 Badanie progu odruchu

Pomiar progu odruchu można zarejestrować jako osobny pomiar lub w ramach sekwencji diagnostycznej. W przypadku badań sekwencyjnych badanie automatycznie sugeruje poziom progu. Należy zawsze uważnie przejrzeć ten wynik i w razie potrzeby dokonać korekty.

Poniżej zamieszczono opis wykonywania badania progu odruchu jako pojedynczego badania. Oznacza to, że funkcja sekwencji jest wyłączona.

Uwaga • Przed wykonaniem pomiaru odruchu strzemiączkowego zalecane jest przeprowadzenie badania tympanometrycznego, a przed pomiarem zaniku odruchu zalecane jest ustalenie progu odruchu strzemiączkowego.

Rozpoczynanie badania

1. Wybierz badanie ręczne.
2. Poproś pacjenta, aby podczas badania siedział nieruchomo i cicho oraz aby nie wykonywał ruchów głową ani szczęką.
3. Uprzedź pacjenta, że w trakcie badania wystąpią wysokie poziomy dźwięku.
4. Naciśnij przycisk odruchu **Ipsi** (Ipsi) lub **Kontra** (Contra).
5. Wybierz częstotliwość do przebadania: Kliknij odpowiedni przycisk strzałki.
6. W razie potrzeby można przesunąć ciśnienie w celu ustabilizowania pomiarów: Kliknij odpowiedni przycisk strzałki.
7. Ustaw poziom bodźca. Kliknij odpowiedni przycisk strzałki.

Uwaga • W przypadku osiągnięcia limitu ostrzegawczego wyświetlane jest ostrzeżenie o wysokim poziomie natężenia bodźca.

8. Naciśnij przycisk **Prezentuj** (Present), aby zaprezentować pojedynczy bodziec.
9. W razie konieczności powtórz te kroki do momentu uzyskania odpowiednich pomiarów.

Ostrzeżenie • Jeśli pacjent odczuwa dyskomfort podczas badania, zatrzymaj badanie. Badanie zostanie natychmiast przerwane. Wyniki już zmierzone są zachowywane.


Zatrzymywanie badania


Badanie zostanie zatrzymane automatycznie, ale w razie potrzeby można je też zatrzymać ręcznie.

1. Kliknij przycisk **Zatrzymaj** (Stop) w panelu sterowania lub przycisk **Uruchom/Zatrzymaj** (Start/Stop) na sondzie.
2. Badanie zostanie natychmiast przerwane.

7.9.1.1 Ekran progno odruchu

Po rozpoczęciu pomiaru jego wyniki są przedstawiane w czasie rzeczywistym na ekranie.

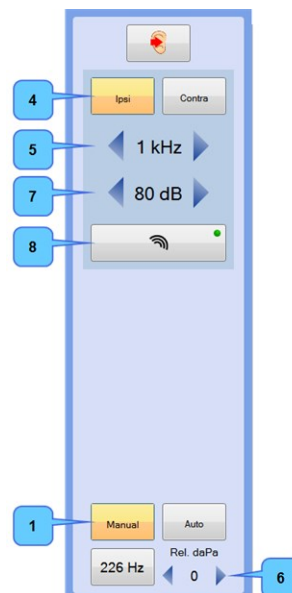

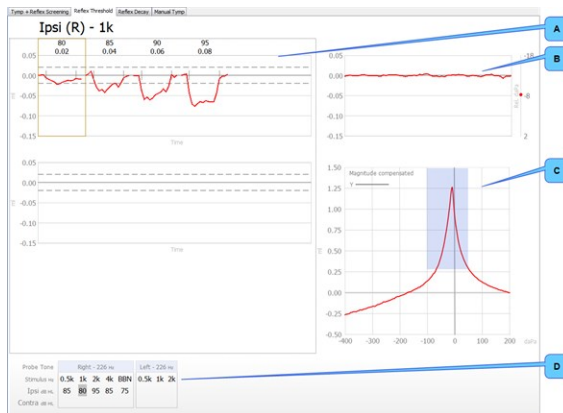

- A. Krzywe odchylenia progu odruchu
- B. Wykres linii bazowej na żywo
- C. Tympanogram
- D. Tabela danych progów

A. Krzywe odchylenia progu odruchu

Obszar wykresu przedstawia krzywe odchylenia odruchu, powiązany poziom oraz wartości liczbowe odchylenia.

- Krzywe odchylenia odruchu
Wartości liczbowe przedstawione nad każdym wykresem (na przykład Ipsi, 1 k, 80 dB HL) wskazują stronę bodźca, maksymalne odchylenie krzywej i zastosowane natężenie bodźca.
- Określony próg jest oznaczany ramką (ustawienie opcjonalne).
- Przerwana linia pozioma na wykresie odruchu wskazuje predefiniowane kryterium odruchu.

B. Wykres linii bazowej na żywo

Wykres linii bazowej na żywo rozpoczyna pomiar linii bazowej w momencie pomyślnego dopasowania sondy. Przedstawia on stabilność warunków pomiarów fizycznych. Stabilność jest odzwierciedlona bezpośrednio na krzywych odchylenia w przypadku wykonywania pomiaru.

W przypadku szczególnie wysokich tympanogramów często istnieje możliwość poprawy stabilności linii bazowej przez przesunięcie ciśnienia docelowego od szczytowego ciśnienia tympanometrycznego.

C. Tympanogram

W tym widoku jest przedstawiony podstawowy tympanogram.

D. Tabela danych progów

Możesz kliknąć indywidualne pomiary w tabeli danych, aby wyświetlić odpowiednie krzywe odchylenia i przeprowadzić ich edycję.

Ta tabela zawiera ustawienia i wyniki pomiarów.

- Ton sondy w Hz
 - Strona bodźca (Ipsi oznacza ucho z sondą, a Kontra — ucho przeciwne)
 - Częstotliwość bodźca
 - Poziom prog, jeśli określono, lub też Brak odpowiedzi, jeśli określono
- Jeśli dany próg nie został określony, pomiar jest oznaczany znacznikiem

Edycja wyników

Wybierz krzywą, aby przeprowadzić edycję właściwości.

- **Usuń** (Delete)
- **Zamień dane między lewym a prawym uchem** (Swap Data Between Left and Right Ear)
- **Ustaw próg** (Set Threshold)
- **Ustaw brak odpowiedzi** (Set No Response)
- **Usuń informacje o progu** (Remove Threshold Information)


7.9.2**Badanie zaniku odruchu**

Ostrzeżenie • *Badanie Zanik odruchu jest badaniem nadprogowym, w którym poziomy bodźców pozostają wysokie przez dłuższy czas. Należy się upewnić, że nie występują przeciwwskazania do wykonania badania.*

Uwaga • *Przed wykonaniem pomiaru odruchu strzemiączkowego zalecane jest przeprowadzenie badania tympanometrycznego, a przed pomiarem zaniku odruchu zalecane jest ustalenie progów odruchu strzemiączkowego.*

Rozpoczynanie badania

1. Poproś pacjenta, aby podczas badania siedział nieruchomo i cicho oraz aby nie wykonywał ruchów głową ani szczęką.
2. Uprzedź pacjenta, że w trakcie badania wystąpią wysokie poziomy dźwięku. Pomiar trwa około 10 sekund.
3. Naciśnij przycisk odruchu **Ipsi** (Ipsi) lub **Kontra** (Contra).
4. Wybierz częstotliwość do przebadania: Kliknij odpowiedni przycisk strzałki.
5. W razie potrzeby można przesunąć ciśnienie w celu ustabilizowania pomiarów: Kliknij odpowiedni przycisk strzałki.
6. Ustaw poziom bodźca. Poziom jest przedstawiony w obszarze szarych wartości online na wyświetlaczu.
7. Kliknij przycisk **Prezentuj**, aby rozpocząć badanie dla ustawionego wstępnie bodźca.
8. W razie konieczności powtórz te kroki do momentu uzyskania odpowiednich pomiarów.

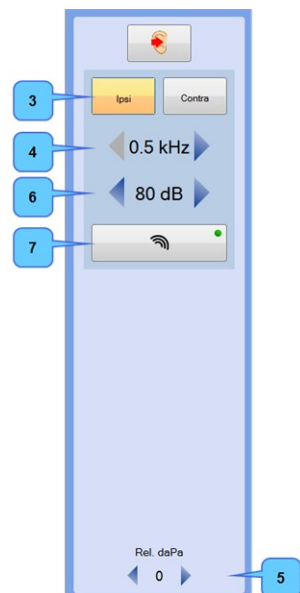

ostrzeżenie • Jeśli pacjent odczuwa dyskomfort podczas badania, zatrzymaj badanie. Badanie zostanie natychmiast przerwane. Wyniki już zmierzone są zachowywane.


Zatrzymywanie badania

Badanie zostanie zatrzymane automatycznie, ale w razie potrzeby można je też zatrzymać ręcznie.

1. Kliknij przycisk **Zatrzymaj** (Stop) w panelu sterowania lub przycisk **Uruchom/Zatrzymaj** (Start/Stop) na sondzie.
2. Badanie zostanie natychmiast przerwane.

7.9.2.1 Ekran zaniku odruchu

Po rozpoczęciu pomiaru jego wyniki są przedstawiane w czasie rzeczywistym na ekranie.

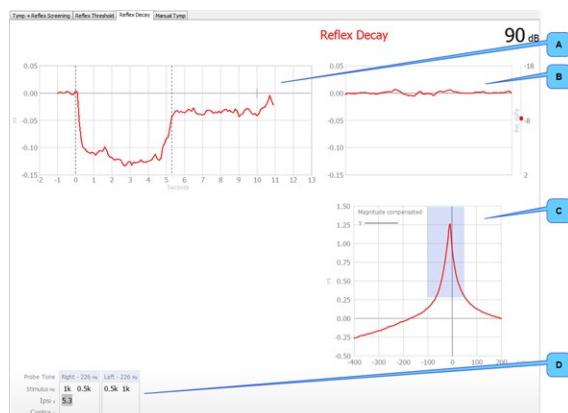

- A. Wykres zaniku odruchu
- B. Wykres linii bazowej na żywo
- C. Tympanogram
- D. Tabela danych zanikania

A. Wykres zaniku odruchu

Wykres przedstawia czas półtrwania i krzywą zaniku odruchu dla wybranego bodźca.

- Znacznik ustawienia bodźca (w razie potrzeby kliknij i przeciągnij, aby wyregulować)
- Znacznik półtrwania (w razie potrzeby kliknij i przeciągnij, aby wyregulować)
- Linia czasowa w sekundach
- Znaczniki włączenia/wyłączenia bodźca
- Krzywa odchylenia dla wybranego bodźca

B. Wykres linii bazowej na żywo

Wykres linii bazowej na żywo rozpoczyna pomiar linii bazowej w momencie pomyślnego dopasowania sondy. Przedstawia on stabilność warunków pomiarów fizycznych. Stabilność jest odzwierciedlona bezpośrednio na krzywych odchylenia w przypadku wykonywania pomiaru.

W przypadku szczególnie wysokich tympanogramów często istnieje możliwość poprawy stabilności linii bazowej przez przesunięcie ciśnienia docelowego od szczytowego ciśnienia tympanometrycznego.

C. Tympanogram

W tym widoku jest przedstawiony podstawowy tympanogram.

Tabela danych zanikania

Możesz kliknąć indywidualne pomiary w tabeli danych, aby wyświetlić odpowiednie krzywe i przeprowadzić ich edycję.

Ta tabela zawiera ustawienia i wyniki pomiarów.

- Ton sondy w Hz
- Strona bodźca
- Częstotliwość bodźca
- Znaczniki włączenia/wyłączenia bodźca

Edycja wyników

W razie potrzeby kliknij i przeciągnij, aby wyregulować

- Znacznik ustawienia bodźca
- Znacznik półtrwania

Wybierz krzywą, aby przeprowadzić edycję właściwości.

- **Usuń krzywą** (Delete Curve)
- **Usuń krzywą dla ekranu dotykowego** (Delete Curve for Touchscreen)

8 Drukowanie wyników badań z oprogramowania OTOsuite

Funkcja drukowania oprogramowania OTOsuite umożliwia wydrukowanie raportu z badania.

tympanometria,

- Kliknij pola wyboru w kolumnie **Drukuj** (Print), aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie krzywych do uwzględnienia w raporcie z badania.

W zależności od wybranego raportu może on zawierać tylko kilka górnych tympanogramów.

Wybierz szablon raportu, który może drukować wymaganą liczbę krzywych.

	Ear	TPP	ECV	SC	TW	Type	Probe
<input checked="" type="checkbox"/>	R	-140	0,6	0,5	62	C	226
<input checked="" type="checkbox"/>	R	-195	1,3	0,2	52	AS	226
<input checked="" type="checkbox"/>	L	70	1,1	1,1	77	C	226
<input checked="" type="checkbox"/>	L	80	2,0	0,4	64	C	226
		daPa	ml	ml	daPa		Hz

9 Rozwiązywanie problemów

9.1 Problemy z sondami — możliwe przyczyny

Badanie może być komplikowane przez wiele czynników, które mogą prowadzić do nieszczelności lub innych problemów z sondą.

- Końcówka uszna nie jest dobrze dopasowana
- Końcówka uszna nie jest poprawnie wprowadzona do przewodu słuchowego
- Otwór końcówki sondy jest zablokowany przez ścianę przewodu słuchowego
- Końcówka uszna jest stara lub stwardniała
- Końcówka sondy nie została zamocowana odpowiednio do korpusu sondy
- Włosy w przewodzie słuchowym dostają się między końcówkę uszną i ściankę przewodu słuchowego
- Końcówka sondy jest niedrożna z powodu zanieczyszczeń lub obecności płynu
- Przeprowadź sprawdzanie sondy, aby wykluczyć usterkę sondy.

10 Serwis, czyszczenie i kalibracja

Ostrzeżenie • W żadnym przypadku nie można rozmontowywać urządzenia MADSEN Zodiac. Należy skontaktować się z dostawcą. Części wewnątrz urządzenia MADSEN Zodiac mogą być sprawdzane i serwisowane tylko przez

upoważniony personel.

10.1 Serwis

Ostrzeżenie • Ze względów bezpieczeństwa oraz zachowania gwarancji czynności serwisowe oraz naprawy sprzętu elektromedycznego powinny być wykonywane tylko przez producenta urządzenia lub personel w autoryzowanych punktach serwisowych. W przypadku stwierdzenia usterek w funkcjonowaniu urządzenia należy sporządzić szczegółową listę usterek i skontaktować się z dostawcą. Nie wolno używać urządzenia, w którym występują usterki.

Wymiana sondy

Sonda diagnostyczna oraz, w stosownych przypadkach, sonda Quick Check, są podłączone na stałe do urządzenia.

Zachować ostrożność • Sondę Zodiac może odłączać i wymieniać jedynie technik autoryzowanego serwisu.

10.2 Czyszczenie urządzenia

Zachować ostrożność • Należy przestrzegać lokalnych zaleceń dotyczących zapobiegania zakażeniom.

Zachować ostrożność • Należy stosować tylko środki czyszczące przeznaczone do czyszczenia urządzenia.

Zobacz [Zalecane środki czyszczące](#) ► 34.

Częstotliwość

Zalecamy ustalenie harmonogramu czyszczenia urządzenia Zodiac i akcesoriów, takich jak sondy i/lub słuchawki.

Wymagania wstępne

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie MADSEN Zodiac i odłącz je od wszelkich zewnętrznych źródeł zasilania.
- W razie potrzeby odłącz słuchawkę kontralateralną od urządzenia MADSEN Zodiac.

Czyszczenie opaski na ramię

Zobacz [Czyszczenie opaski na ramię](#) ► 34.

Czyszczenie końcówki sondy

Zobacz [Czyszczenie sondy i końcówki sondy](#) ► 34.

Usuwanie

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących utylizacji artykułów jednorazowego użytku, takich jak końcówki uszne i nić do czyszczenia końcówki sondy, tzn. można je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

10.2.1 Zalecane środki czyszczące

Zachować ostrożność • Należy stosować tylko środki czyszczące przeznaczone do czyszczenia urządzenia.

W przypadku czyszczenia urządzenia zaleca się stosowanie tylko ściereczek ze środkiem dezynfekującym niezawierającym alkoholu (np. ściereczek do urządzeń audio) lub ściereczki lekko zwilżonej zalecanym środkiem czyszczącym, co zapewnia właściwe zapobieganie zakażeniom i maksymalną trwałość urządzenia.

Zaleca się stosowanie następujących środków chemicznych:

Powierzchnia obudowy i sondy

- Ściereczki ze środkiem dezynfekującym niezawierającym alkoholu (np. ściereczki do urządzeń audio)
- Związki amonowe (np. DBAC), w stężeniach nieprzekraczających 0,1%.
- Roztwory aldehydowe (np. aldehyd glutarowy).
- Środki utleniające (np. nadtlenek wodoru w stężeniach nieprzekraczających 3%).
- Aldehyd ortoftalowy w stężeniach nieprzekraczających 0,6%.

Zachować ostrożność • Namoczenie elementów plastikowych w środku czyszczącym powoduje ich uszkodzenie.

10.2.2 Czyszczenie opaski na ramię

Do czyszczenia opaski na ramię i kontrolera należy stosować miękką ściereczkę zwilżoną niewielką ilością środka czyszczącego.

Jeśli konieczne jest bardziej dokładne wyczyszczenie opaski na ramię, można wyjść opaskę z kontrolera.

10.2.3 Czyszczenie sondy i końcówki sondy

Sondy zaprojektowano z myślą o łatwym czyszczeniu, należy jednak zachować ostrożność, aby zapewnić długi czas ich eksploatacji.

Uwaga • Każdorazowo po użyciu sondy należy sprawdzić kanały dźwiękowe w końcówce sondy. Nawet niewielka ilość woskowiny lub mazi może zablokować kanały dźwiękowe. W razie potrzeby należy wyczyścić kanały dźwiękowe.

Uwaga • Dokładność podczas badania gwarantują tylko końcówki zatwierdzone dla urządzenia MADSEN Zodiac przez firmę Otometrics.

Szczątki z przewodu słuchowego zatykające rurki sondy mogą prowadzić do nieprawidłowo wysokich odczytów objętości przewodu słuchowego, komunikatów o nieszczelnościach i innych dziwnych wyników. Każdorazowo przed użyciem sondy należy sprawdzić kanały końcówki sondy. Nawet niewielka ilość woskowiny lub mazi może zatkać kanały sondy.

Ostrzeżenie • Należy założyć nową końcówkę sondy po wykonaniu badania na zakażonym przewodzie słuchowym. Konieczne może też być wyczyszczenie pierścienia sondy.

Czyszczenie sondy

- Między kolejnymi pacjentami przetrzyj końcówkę sondy środkiem dezynfekującym (np. ściereczką do czyszczenia urządzeń audio) lub wymień sondę na nową.
- Przetrzyj kabel ściereczką ze środkiem dezynfekującym, np. ściereczką do czyszczenia urządzeń audio.
- Przetrzyj uchwyt na sondę ściereczką ze środkiem dezynfekującym, np. ściereczką do czyszczenia urządzeń audio.
- Można też użyć wilgotnej, niepozostawiającej włókien ściereczki z małą ilością zalecanego środka czyszczącego.


Czyszczenie i wymiana końcówki sondy

System jest dostarczany z zamiennymi końcówkami sondy. W razie potrzeby można szybko wymienić końcówkę sondy i wyczyścić bądź wyrzucić starą końcówkę na koniec dnia.

Jeśli końcówka sondy jest tylko częściowo zablokowana, użyj nici do czyszczenia końcówki sondy, aby wyczyścić kanały końcówki sondy.

Uwaga • Zawsze należy przestrzegać lokalnych norm higienicznych dotyczących dezynfekcji.

- A. Korpus sondy
- B. Pierścień sondy
- C. Końcówka sondy

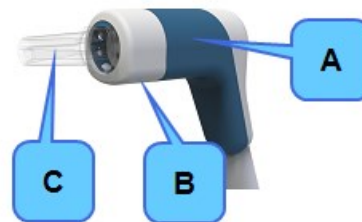

1. Aby zdjąć końcówkę sondy, przytrzymaj sondę za korpus i przekręć pierścień sondy lekko w lewo. Spowoduje to poluzowanie końcówki sondy.




Zachować ostrożność • Nawet najmniejsza ilość wilgoci może rozpuścić osady woskowiny i zanieczyścić delikatne elementy korpusu sondy.

2. Zdejmij końcówkę sondy.



3. Sprawdź, czy kanały dźwiękowe końcówki sondy nie są zatkane. Możesz założyć nową końcówkę na sondę lub wyczyścić kanały dźwiękowe przy użyciu dołączonej nici do czyszczenia końcówki sondy.

Zachować ostrożność • Nigdy nie należy czyścić kanałów dźwiękowych w korpusie sondy, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia sondy.

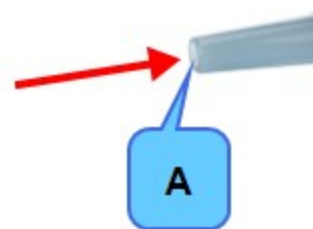

A. Kanały dźwiękowe

4. Załóż końcówkę na sondę i przekręć pierścień sondy w prawo, aby zablokować końcówkę sondy w odpowiednim położeniu na sondzie.

10.2.4 Zagłębienia testowe

Jeśli zagłębienie testowe ulegnie zanieczyszczeniu, nie należy go używać. Należy je zutylizować i wymienić na nowe.

10.3 Kalibracja

Urządzenie i sonda są dostarczane w pełni skalibrowane.

- Urządzenie jest skalibrowane fabrycznie w dB SPL lub dB HL przy zastosowaniu podanych referencyjnych progów równoważnych. Wartości dB HL są powiązane z poziomami ciśnienia akustycznego, dB SPL = dB na 20 μ PA.
- Wartości kalibracji sondy są zapisywane w zestawie sondy i są przenoszone razem z sondą. Sondy są od razu gotowe do użytku. To samo dotyczy kontralateralnej słuchawki dousznej.

Sprawdzanie sondy

Sondę należy sprawdzać codziennie.

Zobacz [Sprawdzanie sondy](#) ► 37.

Można przeprowadzić dodatkowe sprawdzanie admitancji sondy. Zobacz MADSEN Zodiac Poszerzona Instrukcja.

Uwaga • Jeśli środowisko badania ulegnie zmianie, np. wzrośnie wilgotność, albo badanie ma być wykonywane na innej wysokości, należy wykonać sprawdzanie sondy i upewnić się, że system prowadzi pomiary prawidłowo.

Doroczna kalibracja

- Urządzenie i sondy muszą być kalibrowane raz na rok przez autoryzowany dział serwisowy.

Ostrzeżenie • W każdym przypadku należy się też stosować do obowiązujących przepisów lokalnych.

Das Gerät und die Sonden müssen gemäß §11 MPBetreibV einmal jährlich, durch einen autorisierten Wartungsdienstleister, Messtechnisch überprüft und kalibriert werden.

10.4 Sprawdzanie sondy

Aby mieć pewność, że sonda działa poprawnie, zaleca się sprawdzanie sondy na początku każdego dnia.

Zachować ostrożność • Przed włożeniem końcówki sondy do zagłębienia testowego należy zawsze wyczyścić i zdezynfekować końcówkę.

Uwaga • Jeśli środowisko badania ulegnie zmianie, np. wzrośnie wilgotność, albo badanie ma być wykonywane na innej wysokości, należy wykonać sprawdzanie sondy i upewnić się, że system prowadzi pomiary prawidłowo.

1. Użyj nowej końcówki sondy lub przed umieszczeniem końcówki sondy w zagłębieniu testowym upewnij się, że końcówka została wyczyszczona i zdezynfekowana. Ma to na celu upewnienie się, że końcówka sondy nie będzie wpływać na test sondy, a także że zagłębienie testowe nie zostanie zanieczyszczone.
2. Włóż końcówkę sondy bez końcówki usznej do zagłębienia testowego 2 cm3.
3. Wybierz funkcję sprawdzania sondy:

Z systemu OTOSuite:

- Kliknij ikonę **Sprawdzanie sondy** Probe check na pasku narzędzi.

Test sondy rozpocznie się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, kliknij przycisk **Start** (Start), aby rozpocząć test.

Sonda zostanie sprawdzona pod kątem niedrożności i nieszczelności. Jeśli wynik sprawdzania sondy wynosi 1,9-2,1 mmho/cc/ml przy 226 Hz, sonda jest sprawna. W przeciwnym wypadku zaleca się przeprowadzenie kalibracji admitancji.

Można przeprowadzić dodatkowe sprawdzanie admitancji sondy. Zobacz MADSEN Zodiac Poszerzona Instrukcja.

W przypadku błędu sondy

Błąd sondy może oznaczać jej niedrożność lub uszkodzenie.

- Jeśli sonda jest niedrożna, oczyść lub wymień końcówkę sondy.
- Jeśli sonda jest wadliwa, należy skontaktować się z autoryzowanym działem serwisowym w celu przeprowadzenia naprawy.

11 Specyfikacje techniczne

Oznaczenie typu

MADSEN Zodiac jest urządzeniem typu 1096 firmy GN Otometrics A/S

Tabela funkcji

	Quick Check	Diagnostic	Clinical
Tympanometria automatyczna	X	X	X
Tympanometria ręczna		X	X
Historia tymp.	X	X	X
Sonda Quick Check	X	(X)	(X)
Sonda diagnostyczna Classic		X	X
Sonda diagnostyczna Comfort		X	X
Ton sondy, 226 Hz	X	X	X
Ton sondy, 1000 Hz		X	X
Ton sondy, 678 i 800 Hz			X
Sonda podwójna		X	X
Screening odruchów	X	X	X
Próg odruchu (ipsi/kontra)		X	X
Kontra odruchu		X	X
Zanik odruchu		X	X
ETF-I (nienaruszona)		X	X
ETF-P (perforowana)			X
Tympanogramy B i G			X
Rejestrator admitancji			X
Wewnętrzny 2 cm ³			
Komora z wieloma zagłębieniami		(X)	(X)

Zgodność systemu pomiarowego

Ton sondy:	226 Hz przy 85 dB SPL \pm 3 dB 678 Hz przy 72 dB SPL \pm 3 dB 800 Hz przy 70,5 dB SPL \pm 3 dB 1000 Hz przy 69 dB SPL \pm 3 dB
Poziom tonu sondy dynamicznej:	Poziom tonu sondy będzie kompensowany w celu przystosowania do różnych objętości przewodu słuchowego. Poziom wyjściowy będzie zmniejszany dla objętości < 1,7 ml Poziom wyjściowy będzie zwiększany dla objętości > 2,3 ml
THD (próg):	< 1% w 2 cm ³
Dokładność częstotliwości:	\pm 0,5%
Zakres:	Od 0,2 ml do 5,0 ml \pm 5% lub 0,05 ml, w zależności od tego, która wartość jest większa * Od 5,0 ml do 8,0 ml \pm 15% * * Podana dokładność wymaga przeprowadzenia kalibracji na wysokości, na której urządzenie ma być używane

Odruch strzemiączkowy**Czułość**

Próg odruchu + Zanik odruchu:	0,01, 0,02, 0,03, 0,04 lub 0,05 mmho
Badanie przesiewowe odruchu:	0,04 mmho
Wielkość kroku dB:	Diagnostic: 5, 10 dB Clinical: 1, 2, 5, 10 dB

Stymulacja kontralateralna

Czyste tony:	500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz
Dokładność częstotliwości:	\pm 0,5%
Zakres:	BBN, LPN, HPN przy 50 do 110 dB SPL * \pm 3 dB * zmierzone w odpowiednich sprzęgaczach

	<i>Kontralateralna słuchawka douszna:</i>	<i>Słuchawka kontralateralna TDH-39:</i>
Zakres:	500 Hz przy 50 do 115 dB HL \pm 3 dB Od 1000 Hz przy 50 do 120 dB HL \pm 3 dB 2000 Hz przy 50 do 120 dB HL \pm 3 dB 4000 Hz przy 50 do 120 dB HL \pm 3 dB	500 Hz przy 50 do 115 dB HL \pm 3 dB Od 1000 Hz przy 50 do 120 dB HL \pm 3 dB 2000 Hz przy 50 do 115 dB HL \pm 3 dB 4000 Hz przy 50 do 115 dB HL \pm 3 dB
THD (próg):	< 5% dla poziomów poniżej 110 dB HL < 10% dla poziomów powyżej 110 dB HL	< 2,5% dla poziomów poniżej 110 dB HL < 5% dla poziomów powyżej 110 dB HL

Stymulacja ipsilateralna

Ton:	500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz
Dokładność częstotliwości:	± 0,5%
Zakres progów:	Od 500 Hz przy 50 do 105 dB HL ± 3 dB 1000 Hz przy 50 do 110 dB HL ± 3 dB 2000 Hz przy 50 do 110 dB HL ± 3 dB * 4000 Hz przy 50 do 100 dB HL ± 3 dB * W przypadku tonów sondy powyżej 226 Hz mogą zacząć występować artefakty przy poziomach powyżej 105 dB HL.
Zakres badania przesiewowego:	500 Hz przy 70 do 100 dB HL ± 3 dB 1000 Hz przy 70 do 105 dB HL ± 3 dB 2000 Hz przy 70 do 105 dB HL ± 3 dB * 4000 Hz przy 70 do 105 dB HL ± 3 dB * W przypadku tonów sondy powyżej 226 Hz mogą zacząć występować artefakty przy poziomach powyżej 105 dB HL.
THD (próg):	< 5% dla poziomów poniżej 110 dB HL < 10% dla poziomów powyżej 110 dB HL
Zakres:	BBN, LPN, HPN przy 50 do 110 dB SPL * ±3 dB (* zmierzone w sprzęgaczu kalibracyjnym)
Zakres badania przesiewowego:	BBN przy 50 do 90 dB SPL * ±3 dB (* zmierzone w sprzęgaczu kalibracyjnym)
Wielkość kroku dB:	1, 2, 5, 10 dB
Zakres zanikania:	Od 50 do 100 dB HL* (* mogą zacząć występować artefakty przy poziomach powyżej 95 dB HL i objętości 0,5 cm ³)

Charakterystyka czasowa

	Zanik odruchu, Próg i badanie przesiewowe odruchu kontralateralnego	Próg i badanie przesiewowe odruchu ipsilateralnego	Stymulacja kontralateralna — Ton sondy > 226 Hz
Latencja początkowa/końcowa:	0 ms	0 ms ^[1]	0 ms
Czas narastania/opadania:	250 ms	250 ms ^[1]	100 ms
Wysok/niedoskok:	0%	0%	0%

Uwagi:

1. Tolerancja +120/-0 ms

Charakterystyka bodźców impulsowych (ipsilateralnych)	
Bodźce impulsowe są używane w badaniu przesiewowym odruchu ipsilateralnego i badaniu progów odruchu ipsilateralnego.	
Okres:	120 ms
Czas włączenia bodźca:	56 ms
Czas wyłączenia bodźca:	64 ms
Czas narastania/opadania:	5,5 ms

Sterowanie prezentacją bodźca	
Współczynnik Wł-Wył	70 dB (dla poziomu bodźca > 95 dB HL)
Ważony SPL w trybie wyłączenia:	Nauszna kontra TDH 39: 33 dB Douszna kontra: 23 dB

Opis dokładności tympanometrii (daPa/s)

Szybkość pompowania	Min. TW, błąd 5% (daPa)	Min. TW, błąd 10% (daPa)	Min. SA, błąd 5% (daPa)	Min. SA, błąd 10% (daPa)
50 daPa/s	9	7	6	4
100 daPa/s	17	14	11	8
200 daPa/s	24	20	18	14
400 daPa/s	38	31	31	23
600 daPa/s	53	43	42	32

Szum szerokopasmowy

Słuchawka kontralateralna TDH-39

Przepustowość:	250–6000 Hz. Tolerancja ± 5 dB w odniesieniu do poziomu 1 kHz.
Nachylenie:	Poziom widma spada między 6000 a 9500 Hz i pozostaje poniżej -23 dB w odniesieniu do poziomu 1 kHz dla częstotliwości powyżej 9500 Hz.
Poziom:	Poziom szumu jest określany w dB HL. Tolerancja ± 5 dB.

Kontralateralna słuchawka douszna i sonda ipsilateralna

Przepustowość:	400–4000 Hz. Tolerancja ± 5 dB w odniesieniu do poziomu 1 kHz.
Nachylenie:	Poziom widma spada między 4000 a 7000 Hz i pozostaje poniżej -23 dB w odniesieniu do poziomu 1 kHz dla częstotliwości powyżej 7000 Hz.
Poziom:	Poziom szumu jest określany w dB HL. Tolerancja ± 5 dB.

Szum dolnoprzepustowy**Słuchawka kontralateralna TDH-39**

Granica pasma:	1600 Hz (punkt nominalny -3 dB)
Nachylenie:	Nachylenie jest między -12 a -18 dB/oktawę poniżej 1600 Hz, z dodatkową tolerancją ± 6 dB. Powyżej 8500 Hz poziom widma pozostaje poniżej -34 dB w odniesieniu do poziomu 1600 kHz.
Poziom:	Poziom szumu jest określany w dB HL. Tolerancja ± 5 dB.

Kontralateralna słuchawka douszna i sonda ipsilateralna

Przepustowość:	1600 Hz (punkt nominalny -3 dB)
Nachylenie:	Nachylenie jest między -12 a -18 dB/oktawę poniżej 1600 Hz, z dodatkową tolerancją ± 6 dB. Powyżej 8500 Hz poziom widma pozostaje poniżej -34 dB w odniesieniu do poziomu 1600 kHz.
Poziom:	Poziom szumu jest określany w dB HL. Tolerancja ± 5 dB.

Szum górnoprzepustowy**Słuchawka kontralateralna TDH-39**

Granica pasma:	1600 Hz (punkt nominalny -3 dB)
Nachylenie:	Nachylenie jest między +12 a +18 dB/oktawę poniżej 1600 Hz, z dodatkową tolerancją ± 6 dB.
Poziom:	Poziom szumu jest określany w dB HL. Tolerancja ± 5 dB.

Kontralateralna słuchawka douszna i sonda ipsilateralna

Przepustowość:	1600 Hz (punkt nominalny -3 dB)
Nachylenie:	Nachylenie jest między +12 a +18 dB/oktawę poniżej 1600 Hz, z dodatkową tolerancją ± 6 dB.
Poziom:	Poziom szumu jest określany w dB HL. Tolerancja ± 5 dB.

Wartości RETSPL bodźca odruchu ANSI i IEC

Częstotliwości (Hz)	Sonda ipsilateralna HA-1 ^[2]	Słuchawka douszna HA-1 ^[2]	Słuchawka douszna HA-2 ^[2]	Słuchawka nauszna IEC 60318-3/NBS 9A ^[1]	Słuchawka nauszna IEC 60318-1 ^[1]
500	6,0	6,0	5,5	11,5	13,5
1000	0,0	0,0	0,0	7,0	7,5
2000	2,5	2,5	3,0	9,0	9,0
4000	0,0	0,0	5,5	9,5	12,0

BBN ^[3]	6,5	6,0	8,0	12,0	13,5
LBN ^[3]	7,5	9,5	8,5	10,5	11,5
HBN ^[3]	4,0	5,0	7,5	12,5	14,5

Uwagi:

1. Z ANSI/ASA S3.6-2010, tabela 5.
2. Z ANSI/ASA S3.6-2010, tabela 7.
3. Na podstawie wewnętrznego badania Otometrics

System regulacji ciśnienia powietrza

Zakres:	Normalne od +200 do -400 daPa/s. Rozszerzone od +400 do -600 daPa/s
Szybkość przemieszczania ciśnienia:	50, 100, 200, 400, 600 daPa/s \pm 20% przy 20% do 80% łącznego zakresu ciśnienia
Dokładność ciśnienia:	\pm 10% lub \pm 10 daPa, w zależności od tego, która wartość jest większa W przypadku tonów sondy powyżej 226 Hz i objętości poniżej 0,7 cm ³ może wystąpić dodatkowe \pm 10 daPa.
Kierunek pomiaru w pompie:	Od dodatniego do ujemnego albo od ujemnego do dodatniego
Bezpieczeństwo:	Osobne zabezpieczenie +530 daPa i -730 daPa \pm 70 daPa

Jednostki wykresu

Jednostka osi Y wykresu admitancji:	ml, cm ³ , mmho, μ l
Jednostka osi X wykresu:	daPa, s

Ekran urządzenia

Wyświetlacz:	7-calowy, 15:9 WVGA
Rozdzielczość:	800 x 480 pikseli

Złącze portu USB

Typ:	Port urządzenia USB
------	---------------------

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny	XP Power, typ AFM60US24
Wyjście:	24 V, 2,5 A
Wejście:	100–240 V AC, 50–60 Hz, 1,5 A

Pobór mocy

Pobór mocy:	< 70 VA
-------------	---------

Środowisko pracy

Temperatura:	Od +15 do +35°C (od 59 do +95°F)
Wilgotność powietrza:	Od 10 do 90%, bez kondensacji
Ciśnienie powietrza:	Od 600 hPa do 1060 hPa
Czas rozgrzewania:	< 10 min. W przypadku przechowywania urządzenia w warunkach nieodpowiadających określonym warunkom środowiska pracy przed rozpoczęciem korzystania z niego należy pozostawić je na 24 godziny do ogrzania.

Korekta wysokości

Admitancja zagłębienia zależy od ciśnienia atmosferycznego. Oznacza to, że wraz ze zmianą ciśnienia atmosferycznego zmienia się stosunek mmho do ml. Używając poniższej tabeli, można obliczyć różnicę.

Wysokość (m)	Wzrost w mmho (%)
0	0
500	6
1000	13
1500	20
2000	27
2500	36
3000	45

Przechowywanie i obsługa

Temperatura:	Od -20 do +60°C (od -4 do +140°F)
Wilgotność względna:	< 90% bez kondensacji
Ciśnienie powietrza:	Od 500 hPa do 1060 hPa

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

Wersja Wersja autonomiczna:	190 x 248 x 261 mm (7,5 x 9,8 x 10,3 cala)
Wersja Wersja komputerowa:	100 x 240 x 240 mm (3,9 x 9,4 x 9,4 cala)

Wymiary sondy (wys. x szer. x głęb.)

Sonda Quick Check :	28 mm x 22 mm x 100 mm (1,1 x 0,9 x 3,9 cala)
Sonda diagnostyczna:	10 mm x 10 mm x 25 mm (0,4 x 0,4 x 1,0 cal)

Masa

Wersja Wersja autonomiczna:	2,65 kg/5,85 funta
Wersja Wersja komputerowa:	1,65 kg/3,64 funta

Funkcje opcjonalne (Wersja autonomiczna)

Drukarka: Wbudowana drukarka. Drukuje 832 linie punktów na sekundę na papierze o szerokości 112 mm

Sprzęgacz 2 cm³

Kalibracja

Sprzęt powinien być regularnie kalibrowany zgodnie z normami EN 60645-5 i ANSI S3.39

Zasadnicze parametry funkcjonalne

Urządzenie MADSEN Zodiac nie ma zasadniczych parametrów funkcjonalnych, w związku z tym obowiązujące wymagania są określone następująco:

1. Impedancja/admitancja — jak określono w normach EN 61027 typ 1, ANSI S3.39 typ 1.
2. Podstawowe bezpieczeństwo — jak określono w normie IEC 60601-1.

Wszystkie informacje wymagane przez normę IEC 60601-1-2:2007, #5.2.2.1-#5.2.2.10 zawiera MADSEN Zodiac Instrukcja obsługi.

Normy

Bezpieczeństwo:	IEC 60601-1, UL 2601-1, CAN/CSA-C22.2 nr 601.1-90 ANSI/AAMI ES60601-1 + AMD 1, CAN/CSA-C22.2 nr 60601-1 MADSEN Zodiac: EN 60601-1, klasa II, z zasilaniem zewnętrznym, typ BF, IPX0
Kompatybilność elektromagnetyczna:	EN 60601-1-2
Impedancja/admitancja:	Clinical/Diagnostic: EN 60645-5 typ 1, ANSI S3.39 typ 1
Zasilanie:	Klasa I, z zasilaniem zewnętrznym

Usuwanie

Audiometr MADSEN Zodiac można utylizować tak jak typowe odpady elektroniczne, zgodnie z dyrektywą WEEE i przepisami lokalnymi.

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe można znaleźć na karcie danych katalogowych oprogramowania OTOSuite.

11.1 Akcesoria

Wymienione akcesoria zależą od konfiguracji dostarczonego urządzenia MADSEN Zodiac.

- Sonda diagnostyczna, Classic
- Sonda diagnostyczna, Comfort
- Sonda Quick Check
- Końcówki uszne
- Opakowanie końcówek usznych
- Słuchawka douszna Otometrics, kontralateralna

- Słuchawka kontralateralna, TDH-39
- Końcówki douszne do słuchawek kontralateralnych
- Hak opaski na ramię
- Uchwyt na sondę Quick Check, do montażu na ścianie lub na urządzeniu
- Zagłębienie 2 cm3 do sprawdzania sondy
- Zestaw zagłębień dla wielu częstotliwości
- Płyta instalacyjna oprogramowania OTOSuite
- Przewód zasilania
- MADSEN Zodiac Instrukcja obsługi
- MADSEN Zodiac Poszerzona Instrukcja
- Kabel połączeniowy USB
- Zasilacz
- Rolka papieru do wbudowanej drukarki
- Końcówki sondy
- Zestaw uchwytu ściennego do urządzenia w wersji komputerowej
- Zestaw do czyszczenia sondy


11.2 Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

- Urządzenie MADSEN Zodiac jest częścią systemu elektrycznego do zastosowań medycznych i w związku z tym wymaga stosowania szczególnych środków ostrożności. Z tego względu należy stosować się ściśle do instrukcji dotyczących instalacji i eksploatacji zawartych w tym dokumencie.
- Przenośne urządzenia komunikacyjne pracujące w zakresie wysokich częstotliwości (np. telefony komórkowe) mogą zakłócać działanie urządzenia MADSEN Zodiac.

Wytyczne i deklaracja producenta — emisje elektromagnetyczne dla wszystkich urządzeń i systemów		
MADSEN Zodiac jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia MADSEN Zodiac powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.		
Test emisji	Zgodność	Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne
Emisja fal radiowych CISPR 11	Grupa 1	MADSEN Zodiac używa energii fal o częstotliwościach radiowych (RF) tylko do obsługi swoich wewnętrznych funkcji. Dlatego emisja fal radiowych jest bardzo niska i prawdopodobnie nie spowoduje żadnych zakłóceń w sprzęcie elektronicznym znajdującym się w pobliżu.
Emisja fal radiowych CISPR 11	Klasa B	Urządzenie MADSEN Zodiac może być używane we wszystkich środowiskach, w tym w budynkach mieszkalnych oraz budynkach bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci energetycznej niskiego napięcia zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.
Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2	Nie dotyczy	
Wahania napięcia/emisje migotania IEC 61000-3-3	Nie dotyczy	

Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna dla wszystkich urządzeń i systemów			
MADSEN Zodiac jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia MADSEN Zodiac powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.			
Test odporności	Poziom testowy IEC 60601	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne
Wylądowanie elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2	+/- 6 kV (stykowe) +/- 8 kV (przez powietrze)	+/- 6 kV (stykowe) +/- 8 kV (przez powietrze)	Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte płytkami ceramicznymi. Jeżeli podłogi pokryte są materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić co najmniej 30%.
Szybkozmiennne zakłócenia przejściowe IEC 61000-4-4	+/- 2 kV dla przewodów zasilania +/- 1 kV dla przewodów wejścia i wyjścia	+/- 2 kV dla przewodów zasilania +/- 1 kV dla przewodów wejścia i wyjścia	Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska handlowego lub szpitalnego.
Przepięcie IEC 61000-4-5	+/- 1 kV (między przewodami) +/- 2 kV (między przewodami a ziemią)	+/- 1 kV (między przewodami) +/- 2 kV (między przewodami a ziemią)	Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska handlowego lub szpitalnego.
Spadki napięcia, krótkie przerwy i wahania napięcia na liniach wejściowych zasilania IEC 61000-4-11	<5% U_T (>95% spadek wartości U_T) przez 0,5 cyklu 40% U_T (60% spadek wartości U_T) przez 5 cykli 70% U_T (30% spadek wartości U_T) przez 25 cykli <5% U_T (>95% spadek wartości U_T) przez 5 s	<5% U_T (>95% spadek wartości U_T) przez 0,5 cyklu 40% U_T (60% spadek wartości U_T) przez 5 cykli 70% U_T (30% spadek wartości U_T) przez 25 cykli <5% U_T (>95% spadek wartości U_T) przez 5 s	Jakość zasilania powinna być typowa dla środowiska handlowego lub szpitalnego. Jeśli użytkownik urządzenia MADSEN Zodiac wymaga jego ciągłej pracy nawet podczas przerw w zasilaniu sieciowym, zaleca się podłączenie urządzenia MADSEN Zodiac do zasilacza awaryjnego lub akumulatora.
Pole magnetyczne o częstotliwości sieci energetycznej (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Natężenie pól magnetycznych o częstotliwości sieci energetycznej powinno utrzymywać się na poziomach właściwych dla typowych miejsc w środowisku przemysłowym lub szpitalnym.
U _T to napięcie prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.			

Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna dla urządzeń i systemów, które NIE służą do podtrzymywania życia.			
MADSEN Zodiac jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych poniżej. Użytkownik urządzenia MADSEN Zodiac powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.			
Test emisji	Poziom testowy IEC 60601	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

Przewodzone fale radiowe IEC 61000-4-6	3 Vrms od 150 kHz do 80 MHz	3 Vrms od 150 kHz do 80 MHz	Przenośnego i ruchomego sprzętu komunikacyjnego wykorzystującego częstotliwości radiowe należy używać w odległości od dowolnego elementu urządzenia MADSEN Zodiac — w tym również od jego przewodów — nie mniejszej niż zalecana odległość obliczana przy użyciu wzoru odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość: $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ w przedziale od 80 MHz do 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ w przedziale od 80 MHz do 2,5 GHz,
Emitowane fale radiowe IEC 61000-4-3	3 V/m Od 80 MHz do 2,5 GHz	3 V/m Od 80 MHz do 2,5 GHz	gdzie P to maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika w watach (W) podana przez producenta, a d to zalecana odległość w metrach (m). Zmierzone w terenie natężenie pola elektromagnetycznego pochodzącego od stacjonarnych nadajników emitujących fale radiowe powinno być dla każdego zakresu częstotliwości niższe niż poziom zgodności. ^b Zakłócenia mogą występować w pobliżu sprzętu oznaczonego następującym symbolem: 
Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.			
Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na przenoszenie fal elektromagnetycznych ma wpływ ich absorpcja i odbijanie od struktur, przedmiotów oraz ludzi.			
a. Natężenia pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe dla telefonów radiowych (komórkowych / bezprzewodowych) oraz naziemnych radiotelefonów, radia amatorskiego, radiofonii AM i FM oraz transmisji telewizyjnych, nie można dokładnie przewidzieć. W celu oceny środowiska elektromagnetycznego powstałego w wyniku stałych nadajników radiowych należy rozważyć przeprowadzenie badania pola elektromagnetycznego. Jeśli zmierzone natężenie pola w miejscu używania urządzenia MADSEN Zodiac przekracza poziom zgodności stosowny dla fal o częstotliwości radiowej, należy monitorować poprawność działania urządzenia MADSEN Zodiac. Jeśli zostanie stwierdzone, że jego działanie odbiega od normy, może być konieczne zastosowanie innych środków, takich jak zmiana ustawienia lub lokalizacji urządzenia MADSEN Zodiac.			
b. W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być mniejsze niż 3 V/m.			

Zalecane odległości pomiędzy przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe a urządzeniem MADSEN Zodiac			
Urządzenie MADSEN Zodiac jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o kontrolowanych zakłóceniach ze strony pola o częstotliwościach radiowych. Nabywca lub użytkownik urządzenia MADSEN Zodiac może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym, utrzymując minimalną odległość pomiędzy przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe (nadajnikami) a urządzeniem MADSEN Zodiac według poniższych zaleceń, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego.			
Maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika W	Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika		
	od 150 kHz do 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	od 80 MHz do 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	Od 800 MHz to 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73

1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej zalecaną odległość d w metrach (m) można określić, korzystając ze wzoru odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika w watach (W) podana przez producenta.






Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.



Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na przenoszenie fal elektromagnetycznych ma wpływ ich absorpcja i odbijanie od struktur, przedmiotów oraz ludzi.

12 Normy i ostrzeżenia



12.1 Definicje symboli

MADSEN Zodiac

	<p>Sprzęt elektroniczny jest objęty postanowieniami Dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).</p> <p>Po upływie okresu użytkowania wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie oraz akumulatory muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki odpadów. To wymaganie dotyczy obszaru Unii Europejskiej. Tych produktów nie należy utylizować jako zwykłych odpadów komunalnych.</p> <p>Urządzenie i akcesoria można zwrócić do firmy Otometrics lub dostawcy współpracującego z firmą Otometrics. Odpowiednie informacje dotyczące utylizacji produktu można również uzyskać od władz lokalnych.</p>
	Sprawdź w podręczniku użytkownika ostrzeżenia i przestrogi Zachować ostrożność.
	Sprawdź w podręczniku użytkownika ostrzeżenia i przestrogi Zachować ostrożność.
	Produkt jest zgodny z wymogami normy IEC 60601-1 dotyczącymi urządzeń cyfrowych typu BF.
	<p>Produkt jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych oraz Dyrektywy RoHS (2011/65/UE).</p> <p>Produkt jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.</p>

	<p>MEDYCZNE — ogólny sprzęt medyczny zgodny z normą UL 60601-1, wydanie pierwsze, 2003 CAN/CSA-22.2 No. 601.1-M90 w zakresie zagrożeń związanych z porażeniem prądem, pożarem i uszkodzeniem mechanicznym.</p> <p>LUB</p> <p>MEDYCZNE — ogólny sprzęt medyczny zgodny z normami ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012), IEC 60601-1-6, CAN/CSA-C22.2 nr 60601-1 (2014) i CAN/CSA-C22.2 nr 60601-1-6 (2011) w zakresie zagrożeń związanych z porażeniem prądem, pożarem i uszkodzeniem mechanicznym.</p>
	<p>Na terenie Francji urządzenia można używać tylko wewnątrz pomieszczeń.</p>
<p>FCC</p>	<p>To urządzenie spełnia wymogi zawarte w części 15 przepisów FCC. Użytkowanie go podlega następującym warunkom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. • To urządzenie musi przyjmować wszelkie otrzymaniwane zakłócenia, również te mogące powodować jego niepożądane działanie.
<p>IC</p>	<p>Symbol „IC” przed numerem certyfikacji/rejestracji oznacza, że zostały spełnione wymagania techniczne zawarte w przepisach Industry Canada.</p>

Moduł imitancji OTOsuite

 XXXX	<p>Produkt jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych oraz Dyrektywy RoHS (2011/65/UE).</p>
	<p>Wyświetlane w oknach dialogowych z komunikatami o błędach w przypadku wystąpienia błędu programu. Bardziej szczegółowe informacje zostaną wyświetlone w oknie dialogowym.</p>

12.2 Ostrzeżenia

Niniejszy podręcznik zawiera informacje oraz ostrzeżenia, do których należy się stosować, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzeń i oprogramowania będących tematem tego podręcznika. W każdym przypadku należy się też stosować do obowiązujących przepisów lokalnych.

1. Urządzenia tej klasy są dopuszczone do użytkowania w środowiskach mieszkalnych, jeśli są używane pod nadzorem pracownika służby zdrowia.
2. Urządzenie MADSEN Zodiac jest przeznaczone do zastosowań diagnostycznych i klinicznych obejmujących badanie słuchu pacjentów przez audiologów i innych przeszkolonych pracowników służby zdrowia.
3. W przypadku podejrzenia zakażenia w jednym uchu należy wymienić końcówkę uszną i wyczyścić końcówkę sondy przed kontynuowaniem badania drugiego ucha.
4. Aby zapobiec zakażeniom krzyżowym, do badania następnej osoby należy użyć nowych końcówek do uszu.
5. Przypadkowe uszkodzenie lub nieprawidłowa obsługa mogą mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia. Aby uzyskać porady, należy skontaktować się z dostawcą.
6. Ze względów bezpieczeństwa oraz zachowania gwarancji czynności serwisowe oraz naprawy sprzętu elektromedycznego powinny być wykonywane tylko przez producenta urządzenia lub personel w autoryzowanych punktach serwisowych. W

przypadku stwierdzenia usterek w funkcjonowaniu urządzenia należy sporządzić szczegółową listę usterek i skontaktować się z dostawcą. Nie wolno używać urządzenia, w którym występują usterki.

7. Zaleca się zainstalowanie urządzenia w otoczeniu o minimalnym wpływie elektryczności statycznej, np. przy wykorzystaniu antystatycznego pokrycia podłóg.
8. Zalecamy, aby urządzenia nie ustawiać na innych urządzeniach ani w miejscach o słabej wentylacji, ponieważ może to wpłynąć na wydajność urządzenia. W przypadku ustawienia na innym urządzeniu lub obok niego należy się upewnić, że nie wpłynęło to na pracę urządzenia.
9. Nie można przechowywać ani używać urządzenia w temperaturze lub przy wilgotności przekraczającej podane w sekcji Dane techniczne, Przechowywanie i obsługa.
10. Trzymać urządzenie z dala od płynów. Nie dopuścić, aby do urządzenia dostała się wilgoć. Wilgoć wewnątrz urządzenia może spowodować jego uszkodzenie, a także porażenie prądem użytkownika lub pacjenta.
11. Nie można używać aparatu w obecności środków łatwopalnych (gazów) lub w środowisku bogatym w tlen.
12. Nie wolno spożywać, wkładać do ognia ani wykorzystywać żadnych elementów w sposób inny niż opisany w sekcji Przeznaczenie produktu w tym podręczniku.
13. Ryzyko zadławienia! Nie należy pozostawiać końcówek usznych bez nadzoru w miejscach dostępnych dla dzieci.
14. To urządzenie i podłączane urządzenie z własnym zasilaniem powinny być wyłączone przed ustanowieniem połączenia. *Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka sieciowego. Urządzenie nie powinno być umieszczone w sposób utrudniający wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilania z gniazdka sieciowego.*
15. Ze względów bezpieczeństwa i z powodu wpływu na kompatybilność elektromagnetyczną akcesoria podłączane do gniazda sprzętu muszą być tego samego typu co akcesoria oryginalne.
16. Zaleca się przeprowadzenie kalibracji akcesoriów zawierających przetworniki (raz w roku). Ponadto zaleca się przeprowadzenie kalibracji urządzenia w przypadku wystąpienia zdarzenia, które mogło je uszkodzić (np. gdy słuchawki, słuchawki kontralateralne lub sondy spadną na podłogę).
Należy pamiętać, że tylko przetworniki dostarczone razem z systemem zostały poddane kalibracji! Jeśli do wykonywania badań przy użyciu urządzenia ma zostać użyty inny przetwornik, należy wcześniej skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.
17. Akcesoria jednorazowego użytku, takie jak końcówki uszne, nie powinny być używane ponownie i należy je wymienić przed badaniem każdego nowego pacjenta, aby zapobiec zakażeniom krzyżowym.
18. W przypadku wystąpienia silnego sygnału radiowego w sąsiedztwie aparatu mogą pojawić się niepożądane zakłócenia. Takie zakłócenia mogą spowodować nieprawidłowe rejestrowanie pomiarów. Pola o częstotliwościach radiowych mogą być generowane przez wiele rodzajów urządzeń elektrycznych, np. telefony komórkowe. Zaleca się ograniczenie używania takich urządzeń (w maksymalnym stopniu) w sąsiedztwie aparatu.
Podobnie zaleca się, aby przyrząd nie był używany w pobliżu urządzeń wrażliwych na pola elektromagnetyczne.
19. Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez producenta mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
20. Urządzenie oraz zasilacz można utylizować tak jak typowe odpady elektroniczne, zgodnie z lokalnymi przepisami.



21. Należy używać tylko określonego zasilacza.

Zobacz Dane techniczne, Zasilacz.

Osoba montująca system elektryczny do zastosowań medycznych musi wziąć pod uwagę, że podłączenie innego sprzętu, który nie spełnia tych samych norm bezpieczeństwa co ten produkt (np. komputera PC i/lub drukarki), może doprowadzić do obniżenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa systemu. Sprzęt musi spełniać wymagania normy UL/IEC 60950.

Przy wybieraniu akcesoriów podłączonych do urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące informacje:

- Użytkowanie podłączonego sprzętu w środowisku pacjenta
- Dowód przeprowadzenia testów sprzętu zgodnie z normami IEC 60601-1 (3. edycja), AAMI ES60601-1 i CAN/CSA-C22.2 nr 60601-1-08-CAN/CSA.

Nie można dotykać jednocześnie wyjścia wtyczki prądu stałego zasilacza, złączy urządzenia lub podłączonych urządzeń oraz pacjenta.

22. W celu zapewnienia zgodności z wymogami normy IEC 60601-1 (3. wydanie) komputer i drukarka muszą zostać umieszczone poza zasięgiem rąk osoby badanej, tj. w odległości co najmniej 1,5 m/5 stóp.
23. Ten sprzęt został przetestowany i uznany za odpowiadający ograniczeniom stawianym wobec urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Wprowadzenie tych ograniczeń ma na celu ochronę instalacji domowych przed szkodliwymi zakłóceniami. Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować fale radiowe i, jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie ze stosownymi instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia takie nie pojawią się w szczególnym przypadku konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie sprzętu, użytkownik może spróbować wyeliminować te zakłócenia, stosując jedną lub kilka z następujących metod:
- Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
 - Podłączenie sprzętu do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik.
 - Skonsultowanie problemu ze sprzedawcą lub z doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym.

13 Informacje dodatkowe

Więcej informacji można znaleźć w Pomocy online oprogramowania OTOSuite, która zawiera szczegółowe informacje dodatkowe na temat modułów MADSEN Zodiac i OTOSuite.

Instrukcje instalacji OTOSuite zawiera OTOSuite Podręcznik instalacji na nośniku instalacyjnym OTOSuite.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z urządzenia MADSEN Zodiac zawiera MADSEN Zodiac Poszerzona Instrukcja.

Opisane przykłady rozwiązywania problemów zawiera MADSEN Zodiac Poszerzona Instrukcja.

14 Producent

GN Otometrics A/S
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dania
☎ +45 45 75 55 55
✉ +45 45 75 55 59
www.otometrics.com

14.1 Odpowiedzialność producenta

Uważa się, że producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania, niezawodność i działanie sprzętu tylko przy spełnieniu następujących warunków:

- Wszelkie operacje dotyczące montażu, rozbudowy, kalibracji, modyfikacji lub naprawy zostały wykonane przez producenta sprzętu lub personel upoważniony przez producenta.
- Instalacja elektryczna, do której podłączono sprzęt, spełnia wymagania norm EN oraz IEC.
- Sprzęt jest używany zgodnie z instrukcjami użytkowania.

Producent zastrzega sobie prawo do wyłączenia swojej wszelkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowania, niezawodność oraz działanie sprzętu w przypadku jego serwisowania lub napraw wykonywanych przez inne podmioty.

