

MADSEN AccuScreen mit Modemanschluss

Zusatz zum MADSEN AccuScreen OAE & ABR Screener Bedienungsanleitung

Ihr MADSEN AccuScreen ist mit einem Modemanschluss ausgestattet. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie AccuScreen mit einem drahtlosen 3G-Modem verbinden und Daten von Ihrem Gerät direkt zum Trackingcenter übertragen. Das Modem ist vor-konfiguriert und benötigt kein zusätzliches Setup.⁽¹⁾

Anschließen Ihres Modems an die AccuScreen-Ladestation

1. Stellen Sie sicher, dass die Ladestation nicht an einen Computer angeschlossen ist.
2. Stellen Sie das AccuScreen-Gerät in die Ladestation und vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
3. Schließen Sie das Modemkabel an den Anschluss der Ladestation mit der Bezeichnung **Printer/Modem** an. Innerhalb von 15-20 Sekunden nach dem Anschließen des Modems sollte AccuScreen eine Meldung anzeigen, dass das Modem angeschlossen ist.




Aktivieren des drahtlosen Datentransfers

1. Drücken Sie im Fenster **Hauptmenü** die Taste **Datentransfer**.




2. Im Fenster **Datentransfer** drücken Sie **START**, um den Datentransfer zu starten. Die gespeicherten Patientendaten AccuScreen werden automatisch an das Trackingcenter übertragen. Nach dem erfolgreichem Datentransfer wird Ihr AccuScreen automatisch neu gestartet.

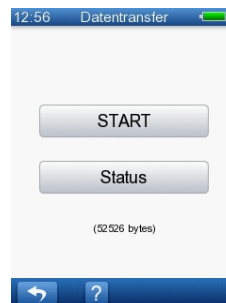

⁽¹⁾Die Hardware (Modem, Kabel und Sim-Karte) wird von GN Otometrics nicht bereitgestellt. Für allgemeine Fragen zu Ihrem Modem wenden Sie sich bitte an info@pathme.de. Bei technischen Problemen mit Ihrem Modem wenden Sie sich bitte an service@pathme.de. Bei Fragen zu Ihrer Sim-Karte wenden Sie sich bitte an Ihren Service-Provider.

Prüfen der drahtlosen Modemverbindung

1. Im Fenster **Datentransfer** drücken Sie **Status**, um eine automatische Überprüfung der Modemverbindung durchzuführen. Die Stärke des Mobilfunksignals wird mit einem blauen Balken angezeigt. Nach 30 Sekunden erscheint erneut das Fenster **Datentransfer**.
2. Verändern Sie eventuell die Position des Modems oder der Empfangsantenne, um so die Signalstärke zu optimieren, zum Beispiel indem Sie das Modem an ein Fenster stellen.

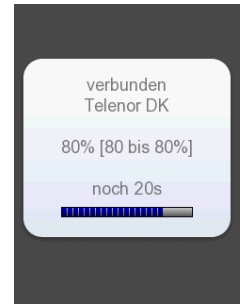

Fehlerbehebung

- Auf meinem AccuScreen erscheint kein Datentransfersymbol.
 - Sie besitzen eine AccuScreen Version, bei der kein Modemanschluss möglich ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen GN Otometrics-Vertreter.
- Wenn ich das Modem anschlieÙe, findet es das AccuScreen-Gerät nicht.
 - Stellen Sie sicher, dass die Ladestation nicht an einen Computer angeschlossen ist.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Modem an die Steckdose angeschlossen haben. Weitere Informationen zur Einrichtung des Modems finden Sie in der Bedienungsanleitung des Modems.
- Wenn ich die Taste **Status** drücke, zeigt der Modemtest einen schlechten Empfang oder die Meldung **kein Netz** an.
 - Prüfen Sie, ob sich im Modem eine gültige Sim-Karte befindet. Anweisungen zum Installieren einer Sim-Karte finden Sie in der Bedienungsanleitung des Modems.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie die Modemantenne richtig installiert haben. Anweisungen zum Installieren des Modems finden Sie im Benutzerhandbuch des Modems.
 - Verändern Sie eventuell die Position des Modems oder der Empfangsantenne, um so die Signalstärke zu optimieren.
- Beim Versuch, Daten zu übertragen, bekomme ich eine Fehlermeldung.
 - Um wieder zum Fenster **Datentransfer** zu gelangen, drücken Sie **OK**.
 - Drücken Sie die Taste **Status** und prüfen Sie die Qualität des Signals. Verändern Sie eventuell die Position des Modems oder der Empfangsantenne, um so die Signalstärke zu optimieren.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie die Modemantenne richtig installiert haben. Anweisungen zum Installieren des Modems finden Sie im Benutzerhandbuch des Modems.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Trackingcenter online ist.

Dok. Nr. 7-50-1640-DE/01 • Teilnr. 7-50-16400-DE

GN Otometrics A/S
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dänemark

+45 45 75 55 55

+45 45 75 55 59

www.otometrics.com



otometrics